

LOTE 6  
LICITANTE 1

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE  
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE SAÚDE  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Número do Pregão: 023/2019SRP  
Objeto: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, conforme especificações no termo de referência, constante dos Anexos do Edital.

Item	Especificação	Marca	Unid.	Qtde.	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit p/ extenso
6	DESTILADOR PRA AGUA	BIO WATER	UNIDADE	1	R\$ 1.843,33	RS 1.843,33	mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos
Valor Total						R\$ 1.843,33	

Valor Total da Proposta: ..... R\$ 1.843,33  
mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos

Prazo de Entrega: conforme os termos do edital  
Prazo de Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento dos bens, referente a tributos, encargos sociais trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.



*[Handwritten signature]*

Declaramos que, cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos que, nos preços já estão incluídas as remunerações, os encargos sociais, tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro, não cabendo nenhum outro ônus que não o valor estipulado na referida Proposta de Preços;

**DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2019**



www.cristofoli.com

LOTE 6  
LICITANTE 2



Cristófoli, a marca  
da proteção.




## Destilador **CRISTÓFOLI**

- Capacidade para destilar até 3,8 litros.
- Prático e econômico.
- Design moderno.
- Fácil de usar.
- Consumo de energia:  
127V - 0,55 kW/hora  
220V - 0,45 kW/hora
- Não necessita instalação hidráulica.
- Baixo consumo de água.



ECOLOGICAMENTE  
**CORRETO**

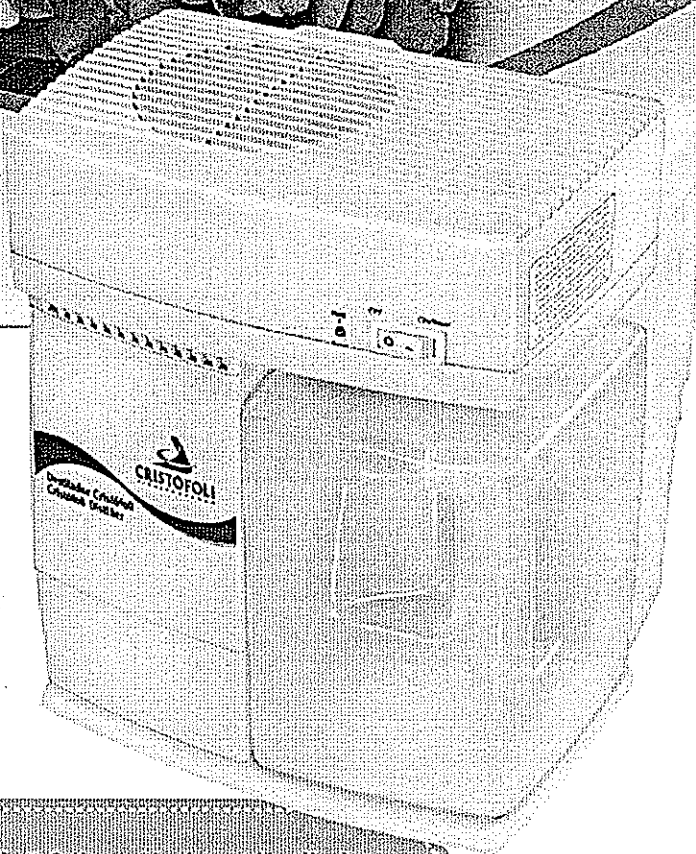

Para produzir 3,8 litros de água destilada, o destilador Cristófoli utiliza somente 4 litros de água! Quando você utiliza água destilada para o último enxágüe dos seus instrumentos, você aumenta sua vida útil.

  
**CRISTÓFOLI**  
BIOSSEGURANÇA

Blog Biossegurança: [www.cristofoli.com/biosseguranca](http://www.cristofoli.com/biosseguranca)  
Consultoria gratuita em biossegurança: [liliana@cristofoli.com](mailto:liliana@cristofoli.com)



LOTE 6  
LICITANTE 3



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA
PROPOSTA
<b>Modalidade e Número do Pregão:</b> Pregão Eletrônico nº 023/2019SRP
<b>Objeto:</b> SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO IÉUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, conforme especificações do termo de referência, constante dos Anexos do Edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA ODONTOLÓGICO	KONDENTEK	UNIDADE	10	R\$ 2.540,00 (dois mil quinhentos e quarenta reais)	R\$ 25.400,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos reais)
02	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	AGIR	UNIDADE	10	R\$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais)	R\$ 4.430,00 (quatro mil quatrocentos e trinta reais)
03	MOCHO ODONTOLÓGICO GIRATÓRIO ESMALTADO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA POLIURETANO INJETADA COM REVESTIMENTO EM COURVIM. BASE TUBULAR EM AÇO DE ALTA RESISTENCIA PINTADO COM TINTA EPOXI-PÓ E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTAS TEMPERATURAS, DIAMETRO DE 3/4" X 12 MM, APOIO TRIPLO, PÉS COM RODÍZIOS DE DUPLO GIRO. REGULÁVEL EM ALTURA ATRAVÉS DE MOVIMENTO GIRATÓRIO DO ASSENTO, ALTURA MÍNIMA: 460 MM, ALTURA MÁXIMA: 700 MM. COM REGULAGEM A GÁS.	QUALITY	UNIDADE	2	R\$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais)	R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
04	BIOMBO PLUMBIFERO CURVO DE 1MM, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, COM VISOR DE VIDRO PLUMBIFERO TAMANHO 10X15CM, MONTADO SOBRE RODÍZIOS, DIMENSÕES: LARGURA - 80 CM, ALTURA 180CM	KONEX	UNIDADE	1	R\$ 12.133,00 (doze mil cento e trinta e três reais)	R\$ 12.133,00 (doze mil cento e trinta e três reais)
05	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	SCHUSTER	UNIDADE	1	R\$ 5.716,00 (cinco mil setecentos e dezesseis reais)	R\$ 5.716,00 (cinco mil setecentos e dezesseis reais)
06	DESTILADOR PRA AGUA	CRISTOFOLI	UNIDADE	1	R\$ 1.843,00 (um mil oitocentos e quarenta e três reais)	R\$ 1.843,00 (um mil oitocentos e quarenta e três reais)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



07	FOTOPOLIMERIZADOR	KONDEN TEK	UNIDADE	1	R\$ 820,00 (oitocentos e vinte reais)	R\$ 820,00 (oitocentos e vinte reais)
----	-------------------	------------	---------	---	--	--

<b>Valor Total do lote: R\$ 51.296,00 (CINQUENTA E UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)</b>
<b>Prazo de Entrega: Conforme os termos do Edital.</b>
<b>Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.</b>
<b>Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.</b>
<b>Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).</b>
<b>Data: 05/12/2019</b>

*ep* *A*

LOTE 6  
LICITANTE 4



NOME DO ORGÃO/MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	SETOR DE LICITAÇÃO
Nº DO PREGÃO: 023/2019 SRP	PREGÃO: ELETRÔNICO

ATRAVÉS DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, SUBSIDIADA PELA LEI Nº 8.666/93 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E, AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE PREGÃO.

DECLARAMOS QUE, NOS PREÇOS APRESENTADOS, BEM COMO NOS LANCES, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE IMPOSTOS, TAXAS, ENTRE OUTROS.

DECLARAMOS AINDA QUE, CUMPRO PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE A CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VL UNIT	VL TOTAL
1	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA ODONTOLÓGICO	UND	10	KONDERTECH	R\$ 2.540,00	R\$ 25.400,00
2	SELADORA PARA PEPEL GRAU CIRÚRGICO	UND	10	2I	R\$ 443,67	R\$ 4.436,70
3	MOCHO ODONTOLÓGICO GIRATÓRIO ESMALTADO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA POLIURETANO INJETADA COM REVESTIMENTO EM COURVIM. BASE TUBULAR EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA PINTADO COM TINTA EPOXI-PÓ E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTAS TEMPERATURAS, DIÂMETRO DE 3/4" X 12 MM, APOIO TRIPLO, PRÉS COM RODÍZIOS DE DUPLO GIRO. REGULÁVEL EM ALTURA ATRAVÉS DE MOVIMENTO GIRATÓRIO DO ASSENTO, ALTURA MÍNIMA: 460 MM, ALTURA MÁXIMA: 700 MM. COM REGULAGEM A GÁS.	UND	2	J.FLEX	R\$ 477,67	R\$ 955,34
4	BIOMÓ PLUMBIFERO CURVO DE 1MM, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, COM VISOR DE VIDRO PLUMBIFERO TAMANHO 10x15CM, MONTADO SOBRE RODÍZIOS, DIMENSÕES: LARGURA - 80 CM, ALTURA: 180 CM	UND	1	LGA	R\$ 12.133,33	R\$ 12.133,33
5	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	UND	1	BIOTRON	R\$ 5.716,67	R\$ 5.716,67
6	DESTILADOR PRA ÁGUA	UND	1	CRISTOFOL	R\$ 1.843,33	R\$ 1.843,33
7	FOTOPOLIMERIZADOR	UND	1	KONDERTECH	R\$ 820,00	R\$ 820,00
VL TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 51.305,37	

#NOME?

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

ITAINGA/CE, 16 DE DEZEMBRO DE 2019.

LOTE 6  
LICITANTE 5



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2019 SRP

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE.

CARTA PROPOSTA

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA ODONTOLÓGICO	UND.	10	D700 ALLIAGE	2.540,00	25.400,00
2	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO	UND.	10	VN	443,67	4.436,70
3	MÓDULO ODONTOLÓGICO GIRATORIO ESPALTADO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOPADO EM ESPUMA POLIURETANO INJETADA COM REVESTIMENTO EM COURVIM. BASE TUBULAR EM AÇO DE ALTA RESISTENCIA PINTADO COM TINTA EPONI-80 E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTAS TEMPERATURAS. DIAMETRO DE 3/4" X 12MM. APOIO TRIPLO, PÉS COM RODÍZIOS DE DUPLO GIRO. REGULÁVEL EM ALTURA ATRAVÉS DE MOVIMENTO GIRATORIO DO ASSENTO. ALTURA MÍNIMA: 460MM, ALTURA MÁXIMA: 700MM. COM REGULAGEM A GAS.	UND.	2	D700 ALLIAGE	498,13	996,26
4	BIOSSO PLUMBIFERO CURVO DE 100, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, COM VISOR DE VIDRO PLUMBIFERO TAMANHO 10X15CM, MONTADO SOBRE RODÍZIOS, DIMENSÕES: LARGURA - 80 CM, ALTURA 1 180CM	UND.	1	KONEX	12.926,40	12.926,40
5	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	UND.	1	D700 ALLIAGE	5.716,67	5.716,67
6	DESTILADOR PRA AGUA	UND.	1	D700 ALLIAGE	1.843,33	1.843,33
7	FOTOPOLIMERIZADOR	UND.	1	KONDENTECH	820,00	820,00
Valor Global da Carta Proposta R\$						52.139,36
CINQUENTA E DOIS MIL, CEMTO E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS						

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS.

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

*(Handwritten signatures and initials)*

# LOTE 6 - LICITANTE 6

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

PREGÃO ELETRONICO N° 023/2019-SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE



ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA ODONTOLÓGICO	UNID	10	ALT	R\$ 3.750,00	R\$ 37.500,00
2	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO	UNID	10	M SELP	R\$ 567,00	R\$ 5.670,00
3	MOCHO ODONTOLÓGICO GIRATÓRIO ESMALTADO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA POLIURETANO INJETADA COM REVESTIMENTO EM COURVIM. BASE TUBULAR EM AÇO DE ALTA RESISTENCIA PINTADO COM TINTA EPOXI-PÓ E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTAS TEMPERATURAS, DIAMETRO DE 3/4" X 12 MM, APOIO TRIPLO, PÉS COM RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, REGULÁVEL EM ALTURA ATRAVÉS DE MOVIMENTO GIRATÓRIO DO ASSENTO, ALTURA MÍNIMA: 460 MM, ALTURA MÁXIMA: 700 MM. COM REGULAGEM A GÁS.	UNID	2	IFLEX	R\$ 807,00	R\$ 1.614,00
4	BIOMBO PLUMBIFERO CURVO DE 1MM, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, COM VISOR DE VIDRO PLUMBIFERO TAMANHO 10X15CM, MONTADO SOBRE RODÍZIOS, DIMENSÕES: LARGURA - 80 CM, ALTURA : 180CM	UNID	1	N MARTINS	R\$ 8.694,39	R\$ 8.694,39
5	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	UNID	1	FIAC	R\$ 4.767,00	R\$ 4.767,00
6	DESTILADOR PRA AGUA	UNID	1	CRISTOFOLI	R\$ 1.887,00	R\$ 1.887,00
7	FOTOPOLIMERIZADOR	UNID	1	SCHUSTER	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00
					R\$	61.272,39

<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>	<b>R\$</b>	<b>61.272,39</b>
sessenta e um mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos		

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DOS BENS, REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

FORTALEZA, 16 DE DEZEMBRO DE 2019.



LOTE 6 - LICITANTE 7

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2019

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA



Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
01	APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA ODONTOLÓGICO MODELO: ULTRASSOM MAGNUS MARCA: DENTEMED EQUIP. ODONT. NACIONAL FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. NACIONAL PROCEDENCIA: NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600008	UND	10	R\$ 2.540,00	R\$ 25.400,00
02	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO MODELO: SELABEM MARCA: BIOTRON FABRICANTE: BIOTRON PROCEDÊNCIA: NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	UND	10	R\$ 443,67	R\$ 4.436,70
03	MOCHO ODONTOLÓGICO GIRATÓRIO ESMALTADO REVESTIMENTO EM COURVIM. BASE TUBULAR EM AÇO DE ALTA RESISTENCIA PINTADO COM TINTA APOPIO TRIPLO, PÉS COM RODIZIOS DE DUPLO MOVIMENTO GIRATÓRIO DO ASSENTO, ALTURA MINIMA: 460 MM, ALTURA MÁXIMA: 700 MM. COM REGULAGEM A GAS. "Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2008 e ISO 13.485/2004". MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS PRATA ANATÔMICO COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA: NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	UND	02	R\$ 477,67	R\$ 955,34
04	BIOMBO PLUMBIFERO CURVO DE 1MM, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, COM VISOR DE VIDRO PLUMBIFERO TAMANHO 10X15CM, MONTADO SOBRE RODIZIOS, DIMENSÕES: LARGURA - 80 CM, ALTURA 180CM MODELO: 180X80 CM CURVO COM VISOR DE 01MM PB MARCA: BARBIERI FABRICANTE: J.C.BARBIERI E CIA LTDA PROCEDENCIA: NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	UND	01	R\$ 12.133,33	R\$ 12.133,33
05	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MODELO: PRIME AIR 40 MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. NACIONAL PROCEDENCIA: NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	UND	01	R\$ 5.716,67	R\$ 5.716,67
06	DESTILADOR PRA AGUA MODELO: DESTILADORA 110V OU 220V MARCA: CRISTOFOLI	UND	01	R\$ 1.843,33	R\$ 1.843,33

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



	FABRICANTE: CRISTOFOLI PROCEDENCIA IMPORTADO RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)					
07	FOTOPOLIMERIZADOR MODELO: LED - 5 MARCA: KONDENTECH FABRICANTE: KONDENTECH PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80022409009	UND	01	R\$ 820,00	R\$ 810,00	

VALOR TOTAL DO ITEM ..... R\$ 51.305,37  
(CINQUENTA E UM MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

Declaramos que esta proposta tem validade conforme Edital, no prazo de 60 (SESSENTA) DIAS, contados da data de abertura da mesma, e que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos Anexos.:

- Valor total da Proposta: R\$ 51.305,37 (CINQUENTA E UM MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)
- Prazo de Entrega: 10 (DEZ) DIAS - CONFORME EDITAL
- Prazo de validade da Proposta: 60 DIAS (SESSENTA DIAS ) - CONFORME EDITAL

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Belo Horizonte, 13 de Dezembro de 2019.

LOTE 6  
LICITANTE 8



Proposta Cliente : 19456

Página: 1

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Processo: PE 23 2019

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	------------	------	-----	--	---------------	-------------

01	254174	10	UN	REF. FÁBRICA: 1.01.05089	2.254,67	22.546,70
----	--------	----	----	--------------------------	----------	-----------

AP ULTRASSOM JATO SONIC PRIME ANALOGICO BIVOLT ECEL  
EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO ANALOGICO COM  
MODERNO SISTEMA DE PROFILAXIA GABINETE CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO  
RESISTENTE COMPOSTO POR CORPO BASE E TAMPA, PAINEL CONFECCIONADO EM  
POLICARBONATO AUTOADESIVO LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL DO GABINETE  
QUE POSSUI AS FUNÇÕES E COMANDOS DO EQUIPAMENTO. PRESSURIZAÇÃO  
INTERNA DO AR E DA AGUA OCORRE NOS TERMINAIS DE ENTRADA E ATRAVÉS  
DAS VÁLVULAS SOLENOIDES O REGISTRO DE AGUA E AR PERMITE AJUSTE FINO.  
PECA DE MAO DO ULTRASSOM COM TRANSDUTOR MONTADO COM PASTILHAS  
CERÂMICAS PIEZOELETRICA FORNECE OSCILAÇÕES COM FREQUÊNCIAS ENTRE  
29KHZ A 32KHZ O CONTROLE DA POTENCIA E AJUSTÁVEL. A PECA DE MAO DO  
JATO DE BICARBONATO COM DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURA DO  
AR AGUA E BICARBONATO A UM PEQUENA DISTANCIA DA PONTA. RESERVATÓRIO  
PARA BICARBONATO COM O RECIPIENTE REMOVÍVEL E FILTRO DE AR PARA  
DRENAGEM SEMI-AUTOMATICA. PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO E AS  
CAPAS DA PECA DE MAO DO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E  
AUTOCLAVAVEL. PRESSÃO ENTRADA DE AGUA 138 KPA A 276 KPA, PRESSÃO  
ENTRADA DE AR 483 KPA A 552 KPA BIVOLT 127V / 220V SELECIONAVEL  
DIMENSÕES COMP X LARG X ALT 245X205X155MM PESO LIQUIDO 3,55KG PESO  
BRUTO 4,35KG GARANTIA 12 MESES INCLUSO 3 INSERTOS 1 CHAVE PARA INSERTO 1  
FUSIVEL IA  
M - SONIC PRIME F - ECEL P - NAC RMS 80366400010

VLR UNITARIO: DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS  
VLR TOTAL: VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

02	248271	10	UN	REF. FÁBRICA: P079	259,02	2.590,20
----	--------	----	----	--------------------	--------	----------

SELADORA 30CM SELABEM BIVOLT BIOTRON  
SELADORA DESIGN MODERNO E INOVADOR COM ALCA DE APOIO PARA SELAGEM  
COM PROTECAO TERMICA QUE EVITA ACIDENTES. APOS AQUECIDA, SELAMENTO  
INSTANTANEO EM 3 SEGUNDOS. CHASSI METALICO DE ACO COM TRATAMENTO  
ANTICORROSIVO E PINTURA EPOXI ELETROSTATICA CONFERINDO SEGURANCA A  
QUALIDADE E DURABILIDADE AO PRODUTO. AREA DE SELAGEM EM ACO  
INOXIDAVEL. AQUECIMENTO UNIFORME EM TODA A AREA DE SELAGEM.  
ACIONAMENTO ATRAVES DE CHAVE LIGA/DESLIGA COM ILUMINACAO. NAO  
NECESSITA MANUTENCOES. ESPECIFICACOES TECNICAS: ALIMENTACAO BIVOLT  
TEMPO DE PRE AQUECIMENTO MEDIA DE 7 MINUTOS TEMPO DE SELAGEM DEPOIS  
DE AQUECIDA 3 SEGUNDOS DIMENSOES DO PRODUTO 36X11X6 5 CM . POTENCIA  
50W AREA DE SELAGEM 30CMX14MM AREA SELADA 25CMX10MM. GARANTIA DE 1  
ANO.  
\*\*\*\*\*FAVOR INFORMAR VOLTAGEM NO EMPENHO\*\*\*\*\*  
M- SELABEM F- BIOTRON P-NAC RDC-185

VLR UNITARIO: DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS  
VLR TOTAL: DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE CENTAVOS

03	254992	2	UN	REF. FÁBRICA:	755,28	1.510,56
----	--------	---	----	---------------	--------	----------

MOCHO A GAS BACK SYSTEM GG EQUIPAMENTOS  
MOCHO A GAS COM ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS E ESTOFADOS REVESTIDO  
EM CURVIM SISTEMA DE ELEVACAO DO ASSENTO, ALTURA REGULAVEL COM



Proposta Cliente : 19456

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Processo: PE 23 2019

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				ALAVANCA LATERAL ENCOSTO COM REGULAGEM SISTEMA BACK SYSTEM ALTURA MINIMA 420MM ALTURA MAXIMA 540MM BASE GIRATORIA COM 05 RODIZIOS DUPLOS EM NYLON INJETADO PISTAO EM ACO INOX ESTRUTURA DOS PES METALICA REVESTIMENTO EM PVC M – BACK SYSTEM F – GG EQUIPAMENTOS P – NAC RDC 260		
				VLR UNITARIO: SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS VLR TOTAL: UM MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS		
04	254781	1	UN	REF. FÁBRICA: IMM CV MAD CD BIOMBO IMM PB CURVO 180X80CM C VISOR MAD CV HDX BIOMBO PLUMBIFERO CURVO COM VISOR ACABAMENTO MDF CONSTRUIDO COM ESTRUTURA EM ACO E REVESTIDO COM PINTURA EM EPOXI ELETROSTATICA. INSTALADO SOBRE 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE ALTA RESISTENCIA E ACABAMENTO EM INOX ESPESSURA: IMM CHUMBO PINTURA: EPOXI ELETROESTATICA DIMENSAO: 180 X 80CM COM VISOR 10X15CM M – HDX F – HDX P – NAC	5.258,85	5.258,85
				VLR UNITARIO: CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS VLR TOTAL: CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS		
05	15302	1	UN	REF. FÁBRICA: 8975706092 COMPRESSOR ISENTO CD TOP 7 30L BIVOLT FIAC COMPRESSOR ISENTO DE OLEO, RESERVATORIO 30LT, VOLUME DE AR A SPIRADO 7,06PCM 200LTS/MIN, PRESSAO MAX. DE OPERACAO 120LBF/ POL, 1 CABECOTE, 1 ESTAGIO, NIVELDE RUÍDO 75DBA, PINTURA INT ERNA,REGULADOR DE PRESSAO,ACIONAMENTO DO MOTOR DIRETO DIMENSOES: 60X31X70CM PESO 28,5KG.COM VALVULA SEGURANCA GARANTIA 01 ANO POTENCIA 1,5CV, ROTACAO 1700RPM, PRTO TEOR ELETRICO, BIVOLT. M-CD TOP 7/30 F-FIAC P-NAC RMS:RDC 185	3.029,78	3.029,78
				VLR UNITARIO: TRÊS MIL, VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS VLR TOTAL: TRÊS MIL, VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS		
06	255582	1	UN	REF. FÁBRICA: DESTILADOR DE AGUA 127V BIOTRON DESTILADOR DE AGUA PURIFICA A AGUA, ELIMINANDO 99,9% DAS IMPUREZAS PRATICIDADE DE OBTENÇÃO SOMENTE A QUANTIDADE DE AGUA NECESSARIA PARA DETERMINADOS PROCEDIMENTOS; LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO; PARTES INTERNAS DE ACO INOXIDAVEL GARANTINDO MELHOR RESISTENCIA E DURABILIDADE; SENSOR PARA DESLIGAMENTO AUTOMATICO QUANDO ACABAR A AGUA CAMARA; PORTATIL, DESIGN MODERNO E INOVADOR; CONFECCIONADO EM MATERIAL DE FACIL LIMPEZA; FILTRO DE CARVAO ATIVADO, PARA ELIMINAR OS TRACOS DE SABOR E ODOR; GARRAFA PLASTICA PARA COLETA DE AGUA. ALIMENTACAO: 220V OU 127V FREQUENCIA: 50/60 HZ POTENCIA: 750W PRODUCAO: 1000 ML/HORA CAPACIDADE MAXIMA: 4 LITROS TEMPERATURA: 160°C DIMENSOES DO PRODUTO: 230 X 230 X 390 MM (C X L X A) DIMENSOES DO PRODUTO EMBALADO: 285 X 260 X 470 MM (C X L X A) PESO DO PRODUTO EMBALADO: 4,400 KG GARANTIA: 1 ANO M – BIOTRON F – BIOTRON P – NAC RDC 260	844,72	844,72
				VLR UNITARIO: OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS VLR TOTAL: OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS		
07	251536	1	UN	REF. FÁBRICA: AP FOTOPOLIMERIZADOR NEW BLUESTAR SEM FIO MICRODONT APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR NEW BLUESTAR S/ FIO 1500MW/MM2 DE POTENCIA, 3 MODOS DE OPERACAO (CONTINUO, PULSADO 1X1 SEG E RAMPA) PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA 100% COERENTE E AUTOCLAVÁVEL FONTE DE ALIMENTAÇÃO FULLRANGE (110/220VAC @ 50A60HZ) BATERIA CAPACIDADE DE	573,12	573,12



Proposta Cliente : 19456

Página: 3

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Processo: PE 23 2019

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				2200MAH VOLTAGEM 3.7V PODE SER RECARREGADA SEM QUE ESTEJA TOTALMENTE DESCARREGADO SEM VICIO, PROTETOR DE RADIAÇÃO LUMINOSA EM ACRILICO POLARIZADO CORPO E BASE CARREGADORA FABRICADO EM POLICARBONATO INJETADOS EM ABS, COM OPÇÃO DE DESCANSO DO APLICADOR CONTROLE DO TEMPO DE APLICAÇÃO PROGRAMAVEL DE 5 A 40S DE 5 EM 5 SEGUNDOS INDIVIDUALMENTE POR MODO COMPRIMENTO DA ONDA DE 450NM A 500NM SISTEMA STAND BY DESLIGAMENTO AUTOMATICO SEM USO APOS 3 MINUTOS M - NEW BLUESTAR F - 3R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI P - NAC RMS 80676929003	

VLR UNITARIO: QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS

VLR TOTAL: QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS

TOTAL DA PROPOSTA: 36.353,93

TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

VALOR TOTAL COM DESCONTO: 36.353,93

PREGAO ELETRONICO 23 2019

MENOR PRECO POR ITEM

CONTRATO 12 MESES

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

ENTREGA 10 DIAS

PAGAMENTO 30 DIAS

LOTE 6  
LICITANTE 9

**GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**  
SETOR DE LICITAÇÃO

(88) 3536-1600  
PREG:JOAB

REF - PREGÃO ELETRÔNICO 0232019

BBMNET

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	P UNIT	P TOTAL
1	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA ODONTOLÓGICO	10	UNID	ALT-ALTRONIC JET CERAMIC	R\$ 2.540,00	R\$ 25.400,00
2	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO	10	UNID	AGIR-PROTECT SEAL BASIC 31 cm	R\$ 443,67	R\$ 4.436,70
3	MOCHO ODONTOLÓGICO	2	UNID	KAVO-FISIOMOCHO	R\$ 477,67	R\$ 955,34
5	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	1	UNID	FIAC-CDTOP7/30	R\$ 5.716,67	R\$ 5.716,67
6	DESTILADOR PRA AGUA	1	UNID	KONDENTECH-AQUATEC	R\$ 1.843,33	R\$ 1.843,33
7	FOTOPOLIMERIZADOR	1	UNID	ECEL-EC450	R\$ 820,00	R\$ 820,00
	TOTAL DA PROPOSTA		UNID		R\$	R\$ 39.172,04

PRAZO DE ENTREGA - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE PAGAMENTO - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA - CONFORME EDITAL.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO -CONFORME EDITAL.

PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS - CONFORME EDITAL.

DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E LEIS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL.


DECLARAMOS QUE NOSSA EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

ARAPONGAS PR 07 DE DEZEMBRO DE 2018



# Aqua-Tech

## Destilador de Água

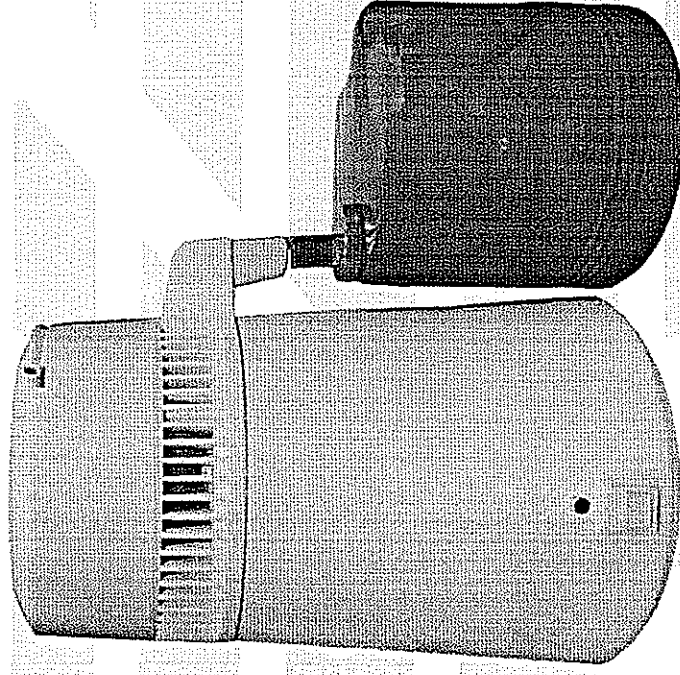

Manual  
do usuário



Rua Gastão Vieira, 471 - São Carlos - SP - CEP: 13562-410  
Fone: 16 3373.7790 - www.kondentech.com.br

## ÍNDICE:

1.	CONFORMIDADE.....	02
1.1.	Diretrizes de Segurança.....	02
2.	INTRODUÇÃO.....	02
3.	INSTALAÇÃO.....	03
3.1.	Geral.....	03
3.2.	Instalações Elétricas.....	03
4.	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO.....	04
5.	MODO DE USAR.....	04
5.1.	Instalações gerais.....	04
5.2.	Instalação do Filtro.....	05
6.	MANUTENÇÃO, MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO.....	06
6.1.	Limpeza geral.....	06
7.	EMBALAGENS, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, SELEÇÃO DO LOCAL, OPERAÇÃO E CONDIÇÕES AMBIENTAIS.....	06
8.	DESCARTE.....	07
9.	DADOS TÉCNICOS.....	08
10.	ADVERTÊNCIA.....	08
11.	GUIAS DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	09
12.	BIOCOMPATIBILIDADE.....	10
13.	GLOSSÁRIOS E SÍMBOLOS.....	10
14.	TERMOS DE GARANTIA.....	11
15.	DADOS DO FABRICANTE.....	11

## 1. CONFORMIDADE

A KONDETECH desenvolveu este equipamento conforme requisitos mundiais da qualidade, priorizando a segurança, compatibilidade eletromagnética e gerenciamento de panes, tornando assim o Aqua-Tech altamente seguro, confiável e robusto. Os principais padrões da qualidade adotados para projeto são:

### 1.1. Diretrizes de Segurança

O Aqua-Tech é um equipamento isento de registro ou cadastro de acordo com a legislação sanitária brasileira. Contudo, recomendamos que sejam seguidas as diretrizes a seguir:

Siga as informações contidas nas etiquetas e leia atentamente este Manual do Usuário antes de ligar e utilizar o equipamento. Toda vez que o símbolo  $\Delta$  for encontrado, leia atenciosamente as recomendações sugeridas.

Este equipamento NÃO É ADEQUADO PARA USO EM PRESENÇA DE MISTURAS INFLAMÁVEIS CONTENDO AR, OXIGÊNIO OU ÓXIDO NITROSO.

- Não utilize este equipamento para quaisquer aplicações domésticas;
- Sempre utilize este equipamento de forma adequada;
- Certifique-se sempre do uso de proteção adequada a cada procedimento;
- O equipamento deve estar conectado eletricamente ao ponto terra;
- Colocar o equipamento em local seguro, evitando submetê-lo a golpes e vibrações;
- Não usar soluções abrasivas para limpeza geral.
- Evite a entrada de qualquer líquido no interior do equipamento;
- Não utilize qualquer componente que não tenha sido citado neste manual. A utilização de componentes diferentes poderá danificar o equipamento;
- O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário;
- Somente substitua o fusível por um do mesmo tipo e classificação;
- Evite a queda do equipamento;
- Se algum componente apresentar dano, o mesmo não deverá ser utilizado;
- Nunca abra o equipamento. Qualquer problema acione a assistência técnica do Fabricante;
- O equipamento deve ser utilizado em ambiente clínico-hospitalar.

## 2. INTRODUÇÃO

Ao adquirir o Aqua-Tech, você optou por um moderno e confiável equipamento indicado para utilização em autoclaves, laboratórios, farmácias de manipulação e todos os procedimentos que exigem utilização de água destilada.





### Finalidade de uso:

O Aqua-Tech é um equipamento projetado para ser utilizado como destilador de água. É importante salientar, que não dispensa a habilidade profissional.



Este equipamento deve ser utilizado somente por pessoas da área de saúde qualificadas e treinadas para o procedimento em que se destina o produto. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

Este equipamento é indicado para utilização em ambientes clínico-hospitalares. Não apresenta efeitos secundários, colaterais ou adversos.

Este Manual do Usuário contém dados sobre montagem, ajustes, operação e manutenção para capacitá-lo ao uso pleno deste equipamento. Procure ter todo o seu conteúdo e mantenha-o sempre à mão para referência e consulta.

Qualquer informação, dúvida, sugestão ou reclamação referente a componentes do dispositivo, por favor, nos avise imediatamente. Conte sempre com nossa equipe técnica para ajudá-lo e guiá-lo de forma a maximizar a utilidade deste equipamento.

Algumas informações técnicas do equipamento são disponíveis apenas para a equipe de técnica, porém, podem ser solicitadas pelos usuários mediante justificativa encaminhada à KONDENTech.

### 3. INSTALAÇÃO

#### 3.1. Geral

O equipamento Aqua-Tech deve ser colocado em uma sala especialmente projetada para acomodar o aparelho, sendo respeitadas as condições de umidade, pressão e temperatura (pode ser usado ar condicionado para manter as condições ambientais necessárias). A temperatura não deve exceder 40°C, conforme informando neste manual/documento.

Para assegurar o funcionamento apropriado do Aqua-Tech, o aparelho deve estar corretamente instalado e as seguintes condições devem ser respeitadas:

- O aparelho não deve ser exposto a fontes de calor ou colocado em áreas sujeitas à água ou umidade;
- Evite a permanência em lugares com a incidência direta de raios solares
- O espaço em torno do equipamento não deve ser menor que 50 cm para resfriamento adequado das partes internas.

#### 3.2. Instalações elétricas

Antes de ligar o aparelho verifique com o auxílio de um eletricitista se a tomada de energia e a fiação elétrica de seu prédio estão bem dimensionadas e em boas condições. O equipamento pode ser adquirido 127V ou 220V, conforme necessidade do cliente.

O plugue do cabo de alimentação está adequado ao padrão brasileiro de tomadas, de acordo com a NBR 14.136, publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). As novas tomadas apresentam novo design, com três orifícios para pinos arredondados, sendo o terceiro para fio terra, atendendo a exigência da norma de instalações elétricas NBR 5410. O equipamento é isolado da rede de alimentação por desconexão do cabo de alimentação.




Figura 1: Plugue

### 4. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

O Destilador portátil elimina totalmente os totais sólidos dissolvidos (minerais, metais pesados, toxinas, ou qualquer outro contaminante).

- Possui alta capacidade "4 Litros": volume suficiente para as mais diversas utilizações;
- Purifica a água em até 99,9%, atendendo a todos os padrões exigidos;
- É portátil e de fácil instalação;
- Resistente e fácil de limpar: corpo cilíndrico inteiramente recoberto por termoplástico;
- Cuba interna construída em aço inoxidável: maior durabilidade e facilidade de limpeza;
- Abastecimento manual, não exige instalações hidráulicas;
- Possui desligamento automático ao final de cada ciclo de destilação.

#### NOTA:

**FILTRO DE CARVÃO ATIVADO:** Quando a água destilada for indicada para consumo humano, deverá ser adquirido o filtro de carvão ativado, deixando a água com um gosto muito mais fresco (item opcional disponível para venda).

### 5. MODO DE USAR

#### 5.1. Instalações gerais:

O Destilador consiste em duas partes principais: a tampa de condensação e a câmara de evaporação. A tampa contém a serpentina de condensação e o mini ventilador. A câmara de evaporação é fabricada em aço inoxidável, com um sistema elétrico de aquecimento na parte inferior.



- Remova a tampa de condensação, enxágue a câmara de inox, depois complete a câmara com água de torneira até a marca máxima que é de aproximadamente 4 litros (não adicionar água acima desta marca);
- Encaixe a tampa de condensação e conecte o cabo da tampa na tomada localizada na base do aparelho;
- Direcione a garrata plástica diretamente abaixo do bico guia de água;
- Conecte o cabo de energia diretamente em uma tomada de corrente elétrica apropriada;
- O destilador irá ligar automaticamente no primeiro uso, quando isto não ocorrer utilize o botão de acionamento "SPSP". O tempo para produzir 4 litros de água destilada é de aproximadamente 4 horas. O destilador desligará automaticamente quando toda a água da câmara for evaporada.



Quantidade de água adicionada	1 Litro	2 Litros	3 Litros	4 Litros
Tempo de aquecimento	8-12 min.	15-20 min.	20-25 min.	30-40 min.
Tempo de finalização	40-60 min.	80-100 min.	130-160 min.	170-200 min.

Caso necessário, use água quente para diminuir o tempo do processo.

## 5.2. Instalação do Filtro


Somente haverá a necessidade de uso do filtro de carvão ativado se a água for destinada ao consumo humano.

- Retire o bico guia localizado na tampa de condensação
- Prepare o filtro de carvão ativado para substituição do bico guia, despeje de 2 a 3 copos de água no filtro antes de cada ciclo de destilação. Após umedecer o filtro basta encaixá-lo na tampa de condensação.


	Sempre verificar a tensão de alimentação do equipamento antes de ligá-lo.
	Este equipamento deve ser utilizado em ambiente hospitalar.

A Instalação é simples e poderá ser realizada pelo próprio cliente, desde que este manual de instrução seja seguido na íntegra. Qualquer dúvida contate o fabricante.


Precauções: Verificar se o encaixe do conector para saída do fluido para o recipiente estão seguros e não apresentam vazamentos.



## 6. MANUTENÇÃO, MANUSEIO E HIGIENIZAÇÃO


	Solicita-se a leitura atenta deste Manual para que seja feita adequada manutenção e limpeza do Aqua-Tech, e sejam executadas somente por pessoas qualificadas. Não é aconselhável o uso de produtos químicos corrosivos e outros.
--	---

- O equipamento deverá ser desligado da rede elétrica antes de ser limpo, a fim de evitar a exposição do usuário a choques elétricos;
- A limpeza do equipamento consiste em passar um pano umedecido em solução detergente neutra, e a seguir um pano seco. A esterilização consiste em passar um pano umedecido em solução desinfetante, deixando o líquido permanecer sobre a superfície em questão, pelo tempo recomendado pelo fabricante. Decorrido esse tempo, passar outro pano umedecido em água e a seguir um pano seco.

	Não deixar escorrer líquidos nos orifícios, pois poderá danificar permanentemente o equipamento.
--	--

Este equipamento não é passível de manutenção pelo usuário ou operador. O fabricante recomenda que este aparelho seja submetido regularmente a uma inspeção preventiva e manutenção, realizado pela própria KONDETECH. A inspeção deste aparelho deve ser realizada anualmente. As inspeções regulares contribuem para detectar eventuais avarias e assim aumentar a segurança e a vida útil do aparelho.

Somente os fusíveis podem ser trocados pelo serviço autorizado, assim como a verificação das funções do equipamento também. Não há partes intercambiáveis no equipamento.

	Utilize somente os serviços de assistência técnica da fábrica ou de agentes autorizados e credenciados pela mesma.
---	--

### 6.1. Limpeza geral

- Recomendamos fortemente que evite deixar seu equipamento exposto à poeira e outros contaminantes.
- Use somente um pano limpo e úmido e sabão neutro para remover poeira, sujeira ou manchas. Um desinfetante também pode ser usado.

## 7. EMBALAGENS, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, SELEÇÃO DO LOCAL, OPERAÇÃO E CONDIÇÕES AMBIENTAIS



- Para transporte ou armazenamento do equipamento, utilize a sua embalagem original, atendendo sempre às suas marcações. Evite mantê-lo em ambientes muito úmidos e com excessiva variação térmica, mesmo que embalado.
- Obedeça às etiquetas de segurança afixadas na embalagem do equipamento, o significado de cada uma delas é descrito neste manual.
- Evite impactos no equipamento (batidas, quedas, etc.). Além dos danos mecânicos, isto pode ocasionar danos ópticos e/ou eletrônicos resultando em perda da calibração realizada em fábrica.
- O local selecionado para armazenamento, transporte e operação deve apresentar condições de temperatura, pressão e umidade controladas. A temperatura deve estar entre 5°C e 40°C, e a umidade relativa máxima é de 80% em 31°C, decaindo linearmente para 50% a 40°C. A pressão deve ser conforme gravidade.
- Não exponha o equipamento à luz solar direta.
- Mantenha o equipamento e sua vizinhança sempre limpos.
- Deve ser utilizado em ambientes fechados.
- Condições de operação:
  - Temperatura 20 a 40°C
  - Umidade relativa 40 a 80 %
- Altitude operacional (MAX) 2000 m acima do nível do mar

#### 8. DESCARTE

O descarte do equipamento ou de peças deve ser feito de acordo com os regulamentos ambientais, diretiva 2002/96/CE, através de empresas de reciclagem ou disposição de resíduos sólidos licenciada no país de atuação. Em caso de descarte do equipamento ou de peças não é necessário o envio à fábrica. Consulte o Distribuidor Autorizado KONDETECH antes do descarte.

Não descarte o produto ou peças juntamente com os resíduos domésticos comuns. Verifique constantemente se todos os componentes do dispositivo não apresentam riscos ao ambiente, à equipe e ao público e se podem ser descartados com segurança de acordo com os protocolos hospitalares ou protocolos ambientais locais.

O descarte do Aqua-Tech e das partes utilizadas, após sua vida útil, é de responsabilidade do usuário e deve atender à legislação local e vigente em sua região.

O Aqua-Tech estando fora de operação deve ser protegido contra utilização inadvertida não qualificada.




Figura 10: Descarte

#### 9. DADOS TÉCNICOS

Especificações Técnicas	
Modelo:	Aqua-Tech
Modo de Operação:	Operação contínua com carga intermitente Líg.:
Tensão de Alimentação:	de 40 à 200min - Desl.:30min. 127V ou 220V
Frequências:	50/60 Hz
Nº de fases:	Monofásico / Bifásico
Potência:	750W
Volume destilado:	1,2L/h
Capacidade da câmara de evaporação:	4L
Capacidade do reservatório (galão plástico):	3,5L
Material interno da câmara de evaporação:	Aço inoxidável
Carcaça externa:	Material termoplástico
Eficiência do calor:	>95%
Filtro (opcional):	Carvão ativado
Dimensões do produto:	380 x 235 mm
Dimensões da embalagem:	450 x 260 x 290 mm
Peso líquido:	3,5 kg
Peso bruto:	4,7 kg

#### 10. ADVERTÊNCIA



A KONDETECH não pode ser responsabilizada pelo equipamento caso ele seja aberto e/ou modificado por pessoas não autorizadas. Nenhuma modificação neste equipamento é permitida.



Caso o equipamento seja utilizado de uma maneira diferente daquela especificada neste Manual, sua garantia será automaticamente cancelada. Leia cuidadosamente as condições de uso. Em caso de dúvida, consulte nossa Assistência Técnica.



	Em caso de acidente ou quaisquer comportamentos anormais entre em contato com a Assistência Técnica. Siga sempre os protocolos médicos autorizados.
<b>ADVERTÊNCIA</b>	Para evitar risco de choque elétrico, este equipamento deve ser conectado apenas a uma rede alimentação com aterramento para proteção.

Você está adquirindo um equipamento de tecnologia de ponta fabricado por uma empresa brasileira. Isso significa que você pode acessar a qualquer hora nosso serviço de atendimento pós-vendas através dos contatos descritos neste manual.

### 11. GUIAS DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Este capítulo apresenta alguns problemas operacionais que o equipamento pode apresentar quando em uso. O usuário pode verificar algumas indicações técnicas que servirão para corrigir o problema, no caso de algo mais simples, ou para facilitar o contato com a assistência técnica da KONDETECH.

PROBLEMA	SOLUÇÃO POSSÍVEL
O equipamento não liga	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Verifique se o cabo A/C está conectado corretamente</li> <li>&gt; Verifique os fusíveis</li> <li>&gt; Verifique se existe tensão elétrica na tomada</li> </ul>
O equipamento interrompe sua operação	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Caso o equipamento esteja desligando aleatoriamente durante sua operação, verifique inicialmente se há dano no cabo, plugue ou tomada. Pode ser necessário instalar um filtro estabilizador, ou preferivelmente, um transformador com isolamento.</li> <li>&gt; Caso o equipamento continue a desligar aleatoriamente, recomenda-se solicitar serviço de técnico especializado da KONDETECH.</li> </ul>
Após um ciclo de destilação completa, obteve-se uma produção baixa de água destilada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Nível baixo de água na cuba.</li> <li>&gt; Tampa de condensação desencaixada da câmara de evaporação. Deve-se regularizar o nível de água. Encaixar a tampa de condensação.</li> </ul>
Vazamento de vapor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Tampa de condensação desencaixada da câmara de evaporação.</li> <li>&gt; Anel de vedação danificado.</li> <li>&gt; Conjunto tampa danificado: serpentina de condensação e/ou mini ventilador. Encaixar a tampa de condensação. Entrar em contato com a assistência técnica.</li> </ul>

Tabela 1: Informações de problemas operacionais e suas respectivas soluções.

*[Handwritten signature]*

	Nunca desconecte o cabo de tensão com o equipamento ligado. Isto pode causar falha e a queima de componentes internos.
	Nunca desconecte a alimentação através de seu cabo, sempre desconecte o plugue.

### 12. BIOCMPATIBILIDADE

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade, que os materiais utilizados nas partes aplicadas do equipamento Aqua-Tech têm sido utilizados amplamente na área médica ao longo do tempo. Dessa forma, considera-se o material utilizado adequado para o fim a que se destina, não havendo risco quanto ao seu uso.

### 13. GLOSSÁRIOS E SÍMBOLOS

Nesse item é apresentado o significado de todos os símbolos apresentados no equipamento, assim como das etiquetas que constam nas embalagens que protegem o equipamento.

Marcação	Significado
	Frágil
	Manter Seco
	Data de Fabricação
	Local de Fabricação
	Empilhamento Máximo
	Proteja contra exposição solar
	Proteja contra radiação
	Não tombar
	Limite de Temperatura
	Atenção: consulte material acompanhante
	Corrente Alternada

Figura 3: Etiquetas, marcações e símbolos.





LOTE 6  
LICITANTE 10



PROPOSTA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal do LAVRAS DA MANGABEIRA - CE  
Att. Senhor(a) Pregociro(a)  
Referente Pregão Eletrônico nº 023/2019 - SRP

Data e Horário de Abertura: 16 de Dezembro de 2019 às 08hs15min  
Data e Horário dos Lances: 16 de Dezembro de 2019 às 10hs00min  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Itém

Condições Gerais da Proposta:

- \* Prazo de Validade da Proposta: 60(sessenta) Dias
- \* Os Produtos terão garantia mínima de 12 (doze) meses.
- \* Prazo de Entrega : Conforme edital.
- \* Prazo para Pagamento: Conforme Edital

Informamos interia submissão às cláusulas e condições existentes no Edital e seus anexos como também aos ditames das Leis e Decretos que regem este

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. UNIT. P. EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL. P. EXTENSO
1	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA ODONTOLÓGICO com jato de bicarbonato. - Sistema piezoelétrico; Peça de mão autoclavável e removível; Bivolt; Filtro de ar com drenagem automática; Controle independente de fluxos de água e pó.	Unid.	10	Scaler Jet	R\$ 2.595,04	dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quatro centavos	R\$ 25.950,44	vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos
2	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO. - De mesa com guilhotina; Material em aço carbono; Sistema para aquecimento com resistência blindada; Área de selagem de 35cm; Bivolt.	Unid.	10	Sela Tech	R\$ 1.599,88	um mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos	R\$ 15.998,80	quinze mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos
3	MOCIO ODONTOLÓGICO GIRATÓRIO ESMALTADO - Assento e encosto em espuma poliuretano injetada com revestimento em courvín. Base tubular em aço de alta resistência pintando com tinta epoxi-pó e secagem em estufa de altas temperaturas, diametro de 3/4 x 12 MM, apoio triplo, pés com rodízios de duplo giro. Regulável em altura mínima; 460 mm, altura máxima; 700mm. Com regulagem a gás.	Unid.	2	Tubomed	R\$ 693,58	seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 1.387,17	um mil, trezentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos
4	BIOMBO PLUMBIFERO CURVO DE 1MM - Construído em chapa de aço tratado e pintado, com visor de vidro plumbífero tamanho 10x15cm, montando sobre rodízios, dimensões; Largura 80cm, altura 180cm	Unid.	1	Tubomed	R\$ 538,76	quinhentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos	R\$ 538,76	quinhentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos
5	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, totalmente isento de Óleo, com capacidade mínima de atendimento a 1 consultório, pressostato automático liga/desliga, resen/atório mínimo de 40 litros, 220V, potência mínima de 2HP, tanque com pintura eletrostática interna e externa, protetor térmico no motor elétrico, regulador de pressão com manômetro, filtro de ar possui, garantia mínima de 12meses.	Unid.	1	Dabi	R\$ 7.101,25	sete mil, cento e um reais e vinte e cinco centavos	R\$ 7.101,25	sete mil, cento e um reais e vinte e cinco centavos
6	DESTILADOR PRA AGUA, mínimo de 3,5 litros por hora, com desligamento , automatico, 220v, garantia mínima de 1 ano.	Unid.	1	Aqua Tech	R\$ 1.414,18	um mil, quatrocentos e quatorze reais e dezoito centavos	R\$ 1.414,18	um mil, quatrocentos e quatorze reais e dezoito centavos
7	FOTOPOLIMERIZADOR de led com fio, modo de operação: rápida gradual e pulsante. Garantia mínima de 12 meses.	Unid.	1	Kondentech	R\$ 719,95	setecentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos	R\$ 719,95	setecentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos
Valor Global da Proposta							R\$	53.110,55
cinquenta e três mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos								

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:	R\$	53.110,55
cinquenta e três mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos		

Fortaleza-Ce., 16 de Dezembro de 2019

Atenciosamente;



**A Pregoeira do Município de LAVRAS DA MANGABEIRA - CE**  
**Referente PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2019 - SRP**  
**DATA E HORA DA ABERTURA: 16/12/2019 às 08h15hs**  
**DATA E HORA DA DISPUTA: 16/12/2019 às 10h00min**

### DECLARAÇÕES

Declara condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação, através dos seguintes procedimentos:

Declara que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;

Verificação da existência de sanção que impeça a participação neste Pregão Eletrônico, ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros em epigrafe no edital.

(1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório; e (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital;

Que atendremos as exigências do edital no que se refere à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que está regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, FGTS E CNDT;

Que temos pleno conhecimento e concordamos com todos os termos e exigências constantes nas cláusulas do referido edital;

Que nos submetemos e estamos de pleno acordo com todos os termos e condições previstas no instrumento convocatório;

Que em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/199, publicada do DOU de 28/10/199, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei n.º 8.666/93;

Que temos pleno conhecimento, aceitação e cumprimos todas as obrigações, parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertado no presente certame licitatório e que nossa proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital;

Que nos valores ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento dos bens, referente a tributos, encargos sociais trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a construção, inclusive a margem do lucro e demais ônus à execução do objeto desta licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente entregar os produtos, objeto desta licitação, caso sejamos vencedores, incluindo quanto à forma e prazo de fornecimento dos produtos.

Validade da Proposta: 60(sessenta) dias, – Prazo de Entrega: de acordo com o edital, ou seja, entregar os produtos no prazo máximo de 30(trinta) dias após o recebimento da Ordem de Compra – Forma de Pagamento: de acordo com o edital.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza (CE), 16 de Dezembro de 2019.

Atenciosamente;

LOTE 6

LICITANTE 10



LOCAL, 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

À  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRA  
 Secretaria de Saúde  
 Comissão Permanente de Licitação

OBJETO: AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE.

**REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023.2019**

**ABERTURA: 16 / 12 / 2019 ÀS 08: 15 H**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE	UND.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
1	APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA ECEL ODONTOLÓGICO		10	UND	3.302,00	33.020,00
2	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO	SISPACK	10	UND	576,77	5.767,70
3	MOCHO ODONTOLÓGICO GIRATÓRIO ESMALTADO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA POLIURETANO INJETADA COM REVESTIMENTO EM COURVIM. BASE TUBULAR EM AÇO DE ALTA RESISTENCIA PINTADO COM TINTA EPOXI-PÓ E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTAS TEMPERATURAS, DIAMETRO DE 3/4" X 12 MM, APOIO TRIPLO, PÉS COM RODIZIOS DE DUPLO GIRO. REGULÁVEL EM ALTURA ATRAVÉS DE MOVIMENTO GIRATÓRIO DO ASSENTO, ALTURA MINIMA: 460 MM, ALTURA MÁXIMA: 700 MM. COM REGULAGEM A GAS.	J. FLEX	2	UND	620,97	1.241,94
4	BIOMBO PLUMBIFERO CURVO DE 1MM, ODONTOLO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E GIC PINTADO, COM VISOR DE VIDRO PLUMBIFERO TAMANHO 10X15CM, MONTADO SOBRE RODIZIOS, DIMENSÕES: LARGURA - 80 CM, ALTURA :180CM		1	UND	15.773,33	15.773,33
5	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	MOTOMIL	1	UND	7.431,67	7.431,67
6	DESTILADOR PRA AGUA	QUIMIS	1	UND	2.396,33	2.396,33
7	FOTOPOLIMERIZADOR	ECEL	1	UND	1.066,00	1.066,00

66.696,97

sessenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$	66.696,97
sessenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos	

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão publica do**





**PRAZO DE ENTREGA:** 10 (dez) dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA pela administração, no local determinado na ORDEM DE COMPRA.

**PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE DOS MATERIAIS:** 12 (DOZE) MESES, Conforme edital

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. (artigo 21, § 2º, do Decreto nº 5450/2005).

Declaramos ainda que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.

lote 7  
licitante 1

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE  
GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE SAÚDE  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Número do Pregão: 023/2019SRP

Objeto: SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, conforme especificações no termo de referência, constante dos Anexos do Edital.

Item	Especificação	Marca	Unid.	Qtde.	Valor Unit	Valor Total	Valor Unit p/ extenso	Valor Total p/ extenso
7	FOTOPOLIMERIZADOR	KONDENTECH	UNIDADE	1	R\$ 820,00	R\$ 820,00	oitocentos e vinte reais	oitocentos e vinte reais
Valor Total						R\$ 820,00		

Valor Total da Proposta: ..... R\$ 820,00  
oitocentos e vinte reais

Prazo de Entrega: conforme os termos do edital  
Prazo de Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento dos bens, referente a tributos, encargos sociais trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos que, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).



Declaramos que, nos preços já estão incluídas as remunerações, os encargos sociais, tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro, não cabendo nenhum outro ônus que não o valor estipulado na referida Proposta de Preços;

**DATA: 16 DE DEZEMBRO DE 2019**




LOTE 7  
LICITANTE 2



# LED-6

Fotopolimerizador

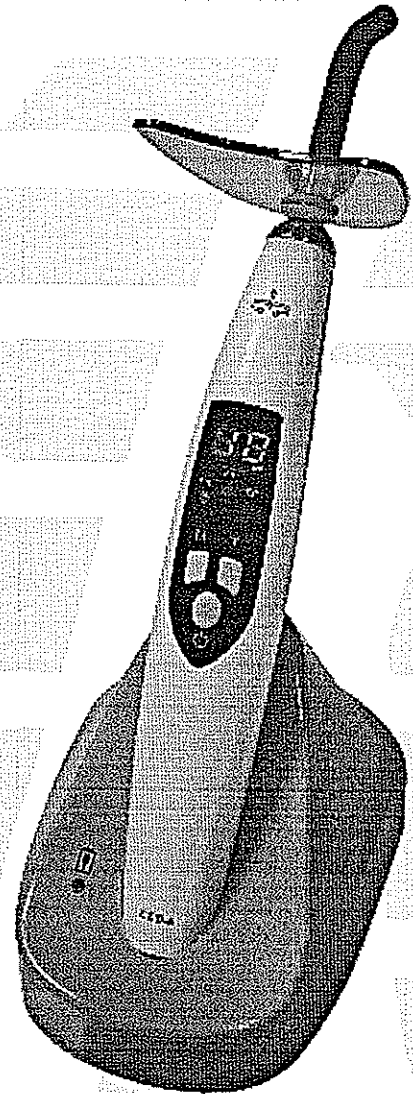

MANUAL DE OPERAÇÃO E SERVIÇOS  
Versão: 02 - 09/09/2013



Rua Gastão Vieira, 471 13562-410 São Carlos SP  
SAK 16 3373-7790 [www.kondentech.com.br](http://www.kondentech.com.br)



*[Handwritten signatures]*





Potência máxima nominal de saída do transmissor (W)	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor (m)		
	150 kHz até 80 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80 MHz até 800 MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800 MHz até 2,5 GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Para transmissores com uma potência máxima nominal de saída não listada acima, a distância de separação recomendada (em metros [m]) pode ser determinada através da equação aplicável para a frequência do transmissor.

**Nota 1:** Em 80 MHz até 800 MHz, aplica-se a distância de separação para faixa de frequência mais alta.

**Nota 2:** Essas diretrizes podem não ser aplicada em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

Tabela 8-5: Recomendações de separação entre equipamentos portáteis e móveis da fonte de emissão de RF Tabela 6 – IEC 60601-1-2, 2007.

<b>CUIDADO</b>	Deve-se utilizar os cabos e acessórios enviados com o LED-6, exclusivamente no produto. A utilização de cabos e acessórios diferentes daqueles especificados neste manual pode resultar em aumento das emissões ou diminuição da imunidade do equipamento. Por outro lado, o uso dos cabos e acessórios enviados com o LED-6 em outro equipamento pode gerar os mesmos problemas de emissão ou imunidade.
<b>PRECAUÇÃO</b>	O LED-6 pode ser afetado por equipamentos que emitam sinais de RF no ambiente em que está instalado.

#### Assistência Técnica

Em caso de problemas contate o fabricante.

Partes do equipamento como Guia da Luz, Placa de Cobertura de Luz, Borracha de Vedação e Bateria de Lítio, podem ser adquiridas separadamente para substituição e reposição.

#### Partes do Equipamento

Somente as partes especificadas abaixo podem ser utilizadas com o equipamento. Caso alguma parte seja danificada, entre em contato com o fabricante para aquisição.

Item Cód.	Peça	Descrição	Qtd
CAN-LED6	Equipamento para emissão de luz	Equipamento energizado internamente por Bateria de Ions de Lítio recarregável, uso intermitente: Após 20 emissões de até 20s aguardar um período de 30 minutos para utilizar novamente. Este equipamento não deve ser utilizado sem uma ponteira apropriada. <b>Comprimento de onda emitida:</b> 430-490nm <b>Intensidade Luminosa:</b> 1500mW/cm <sup>2</sup> <b>Ajuste de tempo de trabalho:</b> 5, 10, 15 e 20 segundos (precisão ±1s). <b>Profundidade de solidificação:</b> Após 20 segundos de irradiação da luz, a profundidade de solidificação da resina é maior que 2 mm.	
BAT-LED6	Bateria de Ion Lítio	Modelo: 18490 1250mAh 3.7V Temperatura de operação: entre -20°C e 45°C	1
BAS-LED6	Base de Carregamento	Estação base de carregamento alimentado por Corrente contínua : 5 V <sub>DC</sub> 2A, uso contínuo. Sempre que o equipamento não estiver sendo utilizado ele deve permanecer na base.	1
GM18-050200	Fonte de Alimentação	Modelo: GM18-050200 Voltagem de entrada: ~100V-240V 50-60Hz Voltagem de saída: ... 5V, 2A, uso contínuo.	1
PLC-LED6	Placa de Proteção (Protetor ocular)	Esta placa permite a visualização da área de aplicação, filtrando a Luz azul refletida na área de aplicação. Tem a função ainda de evitar que o disco metálico do equipamento toque o paciente.	1
PA1-LED6	Ponteira acrílica de fotopolimerização (acessório opcional)	Para foto polimerização de resina, de acordo com os protocolos desta.	-
PO1-LED6	Ponteira de fibra óptica de fotopolimerização	Para foto polimerização de resina, de acordo com os protocolos desta. Esta haste apresenta menor perda de energia luminosa.	1
PA3-LED6	Ponteira acrílica de clareamento para três dentes (Acessório opcional)	Utilizada para clareamento dental.	-
MOP-LED6	Manual	Manual do Usuário	1



**Diretrizes e declaração do fabricante  
Imunidade Eletromagnética**

O LED-6 é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do LED-6 deve garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.

Ensaio de Imunidade	Nível de ensaio da ABNT NBR IEC 60601	Nível de conformidade	Ambiente Eletromagnético Diretriz
RF Conduzida IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz até 80 MHz	3V	Equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel não deveriam ser usados próximos a qualquer parte do LED-6, incluindo cabos, com distância de separação menos que a recomendada, calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. <b>Distância de separação recomendada</b> $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P}$ (80 MHz até 800 MHz) $d = 2,3\sqrt{P}$ (800 MHz até 2,5 GHz)  Onde $P$ é a potência máxima nominal de saída do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor, e $D$ é distância de separação recomendada em metros (m). É recomendada que a intensidade de campo estabelecida pelo transmissor de RF, como determinada através de uma inspeção
RF Radiada IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz até 2,5 GHz	3 V/m	

O ciclo do modo é o seguinte:

Modo Rápido → Modo Pulsar → Modo Gradual → Modo Rápido

Seleção do tempo: pressione o botão para forçar a mudança do tempo. O ciclo do tempo é o seguinte:

5 seg → 10 seg → 15 seg → 20 seg → 5 seg

Quando o equipamento estiver descarregado emitirá intermitentemente três bipes consecutivos e assim, deverá ser recarregado na base.

- A) Colocar a bateria carregada firmemente no aparelho.
- B) Pressione o botão selecionar modo para seu modo de trabalho opcional.
- C) Diminua a pressão do botão, logo depois a luz da haste guia acenderá. Direcione a guia do polimerizador em direção à resina, sem tocar com a ponteira, permanecendo a aproximadamente 1 cm de distancia, assim a resina solidificará. Se você ajustou o tempo de trabalho para 20 segundos, por exemplo, após os 20 segundos o LED será desligado automaticamente. Enquanto o LED estiver acesso, você poderá pressionar o botão de acionamento novamente para interromper a operação.
- D) Este aparelho não pode ser utilizado de forma continua, este está limitada para um funcionamento consecutivo máximo de 10 emissões consecutivas de luz de 20s. Após este uso não deverá ser utilizado por um período de 30 minutos, podendo permanecer na base de carregamento. Deve-se utilizar o aparelho seguindo uma metodologia razoável para o uso pretendido.
- E) Se o aparelho ficar ocioso, após 3 minutos, este volta para o modo de espera automaticamente, e as luzes dos 3 indicadores do LED desligarão.

**A Base**

É utilizada para carregar a bateria do aparelho. O aparelho é inserido na base de recarga, e um bipe é escutado, a luz verde do LED mostra a forma de recarga, quando a luz do LED desligar a bateria estará totalmente recarregada.

**AVISO**

- Não faça alterações deste equipamento sem autorização do fabricante.
- Contate o fabricante em caso de falhas.
- A luz pode provocar danos aos olhos, utilize a placa de proteção corretamente.
- Desinfetar a haste guia antes de utilizar.
- Para uso Profissional apenas.
- Para uso interno apenas.

Se o aparelho não for utilizado todos os dias, a seguinte operações devem ser feitas:


























1. Retire a bateria do equipamento.
2. Mantenha o adaptador principal e a base separadamente.
3. Quando o aparelho for colocado na base, se o som e uma luz verde do LED não são acionados, desligue a força de forma imediata, isto forçará a estabilização do aparelho e voltará ao funcionamento normal.
4. Não coloque a bateria perto do fogo ou em locais com alta temperatura o polo de a bateria entrar em curto circuito.



Ensaio de imunidade	Nível de ensaio da ABNT NBR IEC 60601	Nível de conformidade	Ambiente Eletromagnético Diretriz
Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV por contato ± 8 kV pelo ar	Conforme	Pisos devem ser de madeira, concreto ou cerâmico. Se os pisos forem cobertos com material sintético, a umidade relativa deve ser de pelo menos 30%.
Transitórios elétricos rápidos / trem de pulsos ("Burst") IEC 61000-4-4	± 2 kV nas linhas de alimentação ± 1 kV nas linhas de entrada/saída	Conforme	Qualidade do fornecimento de energia deve ser aquela de um ambiente hospitalar ou comercial típico.
Surtos IEC 61000-4-5	± 2 kV modo comum ± 1 kV modo diferencial	Conforme	Qualidade de fornecimento de energia deve ser aquela de um ambiente hospitalar ou comercial típico.
Quedas de tensão, interrupções curtas e variações de tensão nas linhas de entrada de alimentação IEC 61000-4-11	<5% $U_t$ (> 95% de queda de tensão em $U_t$ ) por 0,5 ciclo. 40% $U_t$ (60% de queda de tensão em $U_t$ ) por 5 ciclos. 70% $U_t$ (30% de queda de tensão	Conforme	Qualidade do fornecimento de energia deve ser aquela de um ambiente hospitalar ou comercial típico. Se o usuário do LED-6 exige operação continuada durante interrupção de energia, é recomendado que o seja alimentado por uma fonte de alimentação ininterrupta ou uma bateria.

**Simbologia utilizada:**

seg: tempo mostrado no display em segundos.

-  Modo rápido
-  Modo Gradual
-  Modo Pulsado
-  Seleção do modo de trabalho
-  Ajuste do Tempo
-  Carga da Bateria em andamento
-  Ligado (com tensão elétrica de alimentação)
-  Consultar Manual do Usuário
-  Frágil
-  Manter Seco
-  Este lado para Cima
-  Data de Fabricação
-  Local de Fabricação
-  Empilhamento Máximo
-  Proteja contra exposição solar
-  Proteja contra radiação
-  Limite de Temperatura
-  Grau de proteção contra choque elétrico, Parte Aplicada Tipo B
-  Atenção consulte material acompanhante
-  Tensão elétrica perigosa
-  Equipamento Classe II
-  Corrente Alternada
-  Corrente Contínua
-  Polaridade do conector
-  Selo de conformidade INMETRO





### Conformidade Normativa e Regulamentar

Projetado e fabricado de acordo com as Normas NBR IEC 60601-1:1990, 60601-1-2:2007, 10993-1:2009.

Este produto possui Certificado INMETRO e registro na ANVISA, estando em total conformidade com as exigências requeridas no Brasil.

### Biocompatibilidade

Declaramos que todos os materiais utilizados em PARTES APLICADAS (conforme norma NBR IEC 60601-1) no Equipamento LED-6, são constituídos de polímeros que têm sido amplamente utilizados na área médica ao longo do tempo, garantindo assim sua biocompatibilidade e deste modo estando em conformidade com o item 6 da norma EN ISO 10993-1:2009.

### Descarte


O descarte do equipamento ou de peças deve ser feito de acordo com os regulamentos ambientais, diretiva 2002/96/CE, através de empresas de reciclagem ou disposição de resíduos sólidos licenciada no país de atuação. Em caso de descarte do equipamento ou de peças, não é necessário o envio à fábrica.

### Consulte o Fabricante antes do descarte.

Verifique constantemente se todos os componentes do dispositivo não apresentam riscos ao ambiente, à equipe e ao público e se podem ser descartados com segurança de acordo com os protocolos hospitalares ou protocolos ambientais locais.

O descarte do LED-6 e das partes utilizadas, após sua vida útil, é de responsabilidade do usuário e deve atender à legislação local e vigente em sua região. O LED-6 estando fora de operação deve ser protegido contra utilização inadvertida não qualificada.

**ATENÇÃO:** Não descarte o produto ou peças juntamente com os resíduos domésticos comuns.



### PADRÕES DE SEGURANÇA ELETROMAGNÉTICA

A seguir estão descritas tabelas que representam a adequação do equipamento às normas de emissão e imunidade eletromagnética.

#### Diretrizes e declaração do fabricante Emissões Eletromagnéticas

O LED-6, é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do O LED-6 deve garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.

Ensaio de imunidade	Conformidade	Ambiente Eletromagnético Diretriz
Emissões de RF ABNT NBR IEC CISPR 11	Grupo 1	O LED-6 utiliza energia de RF apenas para suas funções internas. Assim sendo, suas emissões de RF são muito baixas não sendo provável que causem qualquer interferência em equipamentos eletrônicos próximos.
Emissões de RF ABNT NBR IEC CISPR 11	Classe A	O LED-6 é adequado para utilização em todos os estabelecimentos, que não sejam residenciais, podendo ser utilizado em estabelecimentos residenciais e aqueles diretamente conectados à rede pública de distribuição de energia elétrica de baixa tensão que alimente edifícios públicos utilizados para fins domésticos, desde que o seguinte aviso seja atendido: <b>Atenção:</b> Equipamento pretendido para uso somente por profissionais de saúde. Este equipamento pode causar rádio interferência ou pode interromper a operação de equipamentos próximos. Pode ser necessário tomar medidas mitigatórias, como re-orientação ou re-locação do equipamento ou blindagem local.
Emissões de Harmônicos IEC 61000-3-2	Classe A	
Emissões devido a flutuação de tensão/cintilação IEC 61000-3-3	Conforme	

Tabela 8-2 Informações de conformidade a requisitos de imunidade eletromagnética baseados na Tabela 1 – IEC 60601-1-2, 2007.

#### Diretrizes e declaração do fabricante Imunidade Eletromagnética

LED-6 é destinado para utilização em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do LED-6 deve garantir que ele seja utilizado em tal ambiente.



Por favor, troque o LED quando o intensidade luminosa estiver abaixo 1500mW/cm<sup>2</sup> (utilizando ponteira PO1) testado sobre a mesa de luz especial. O usuário poderá agendar e encaminhar o equipamento a fim de solicitar a verificação a uma assistência especializada, sendo recomendada um intervalo anual a fim de averiguar o correto funcionamento do equipamento.

Recomendação: Para evitar contaminação cruzada sugerimos um isolamento das ponteiras com uma película de plástico, por exemplo, filme de PVC alimentício.

### Manutenção

-Desinfecção da haste do Fotopolimerizador: Fazer a imersão da haste em álcool 75% por 10 minutos.

-O usuário deverá verificar as partes do equipamento ao menos semanalmente ou sempre que perceber algo errado:

-Se a haste do aparelho for danificada ou quebrada, poderá diminuir a sua eficiência de solidificação, deverá ser trocada por uma haste nova.

-Mantenha os terminais da haste limpos, para assegurar a passagem da quantidade correta de luz.

-Se a bateria não for utilizada por um longo período de tempo, recarregue uma vez a cada três meses, retire a bateria do aparelho e mantenha separada.

-Se o anel de vedação gastar, trocar por um novo.

-Se o fotopolimerizador ou peças deste forem descartadas, a bateria deve ser classificada e reciclada por profissionais.

**ATENÇÃO:** Nenhuma das partes do equipamento podem ser esterilizadas por temperatura/autoclave. Realizar somente a desinfecção como recomendado.

### Correção de Falhas

Sinais das falhas	Causas e Reparos
A luz do LED não está brilhante	A. Voltagem da bateria baixa. Recarregue B. Bateria danificada, troque por uma nova
A amplitude do LED é insuficiente	A. Voltagem da bateria baixa. Recarregar B. Haste danificada. Troque por uma nova
Quando a base funciona no Modo de Recarga, a luz do LED acende e o bipe não acontecem	A. Reajustar a base B. Se a ainda não funcionar, verificar a tomada. C. Checar os contatos da bateria
Quando a bateria não carrega ou a luz é fraca	Trocar a bateria e recarregar


Caso não seja possível corrigir os erros como indicado, por favor, entre em contato com o fabricante.

### GARANTIA


O período de garantia do aparelho é de um ano após a fabricação. Se o aparelho não funcionar corretamente dentro deste período, não havendo má utilização, nossa empresa fará o reparo. Porém as peças descartáveis, como a haste, não estão inclusas (caso não seja em consequência de defeito de fabricação).

	em $U_t$ por 25 ciclos. <5% $U_t$ (> 95% de queda de tensão em $U_t$ ) por 5 segundos.		
Campo magnético na frequência de alimentação (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	3 A/m	Conforme	Campos magnéticos na frequência da alimentação deveriam estar em níveis característicos de um local típico em um ambiente hospitalar ou comercial típico.

Tabela 8-3: Informações de conformidade a requisitos de imunidade eletromagnética para equipamentos que não visam o Suporte à Vida baseados na Tabela 2 – IEC 60601-1-2, 2007. NOTA :  $U_t$  é a tensão de alimentação AC antes da aplicação do nível de ensaio.

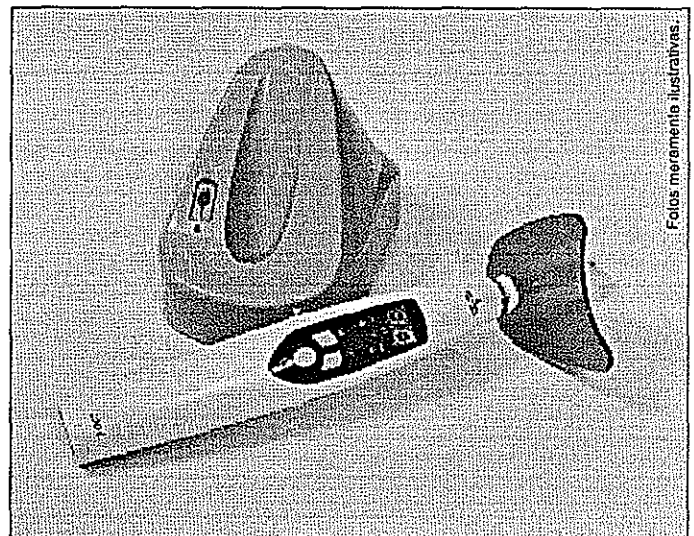

**Diagrama do Produto**

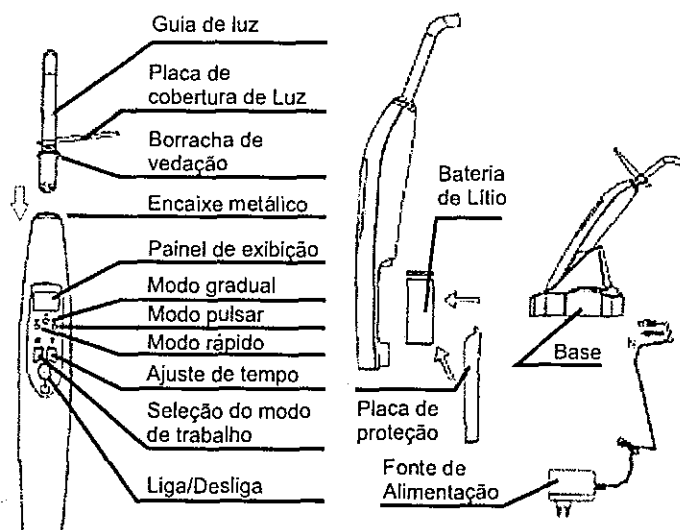

LED	Modo de trabalho
□	Polimerização rápida: Tempo de ajuste 20 segundos
∟	Polimerização gradual: início suave por 10 segundos a partir de 0 até a força total durante os últimos 10 segundos
⌐	Polimerização Pulsante: radiação Interrupta

seg : tempo mostrado no display em segundos

**Guia de Instalação**

Insira a haste guia da luz com o adaptador de fixação no orifício na parte superior do dispositivo. Você deve prestar atenção na posição de inserção, e evitar a inserção na posição oblíqua.

**Conectando à força**

Conecte a fonte de alimentação na base de carregamento, então conecte a tomada à rede elétrica. Insira o equipamento na base de carregamento. Antes do primeiro uso recarregue por no mínimo 6 horas.

**Modo de operação**

O LED do foto polimerizador: Há três botões de pressão nele, e três cores de indicador na parte superior, e uma na tela.

- Pressione o botão para ligar e desligar o aparelho.
- Modo de Seleção: pressione o botão para forçar a mudança do modo :

			eletromagnética no local, a seja menor que o nível de conformidade em cada faixa de frequência. Pode ocorrer interferência ao redor do equipamento marcado com o seguinte símbolo. 
--	--	--	--

**NOTA 1** – Em 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a faixa de freqüência mais alta.

**NOTA 2** – Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

A. As intensidades de campo estabelecidas pelos transmissores fixos, tais como estações rádio base, telefone (celular/sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão rádio AM e FM e transmissores de TV não podem ser previstos teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, recomenda-se que uma inspeção eletromagnética do local. Se a medida da intensidade de campo no local em que o LED-6 é usado excede o nível de conformidade utilizado acima, o LED-6 deveria ser observado para verificar se a operação está normal. Se um desempenho anormal for observado, procedimentos adicionais podem se necessários, tais como a reorientação ou recolocação do LED-6.

B. Acima da faixa de freqüência de 150 kHz até 80 MHz, a intensidade do campo deveria ser menor que 3V/m

Tabela 8-4: Recomendações de distâncias de separação entre o equipamento e fontes de emissão RF baseados na Tabela 4 – IEC 60601-1-2, 2007.

**Distâncias de separação mínimas recomendadas entre os equipamentos de comunicação de RF portátil e móvel e o LED-6.**

LED-6 é destinado para utilização em ambiente eletromagnético no qual perturbações de RF radiadas são controladas. O cliente ou usuário do LED-6 ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo distância mínima entre os equipamentos de comunicação de RF portátil ou móvel (transmissores) e o LED-6, como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída dos equipamentos de comunicação.



Kondentech Indústria e Comércio Ltda - EPP.  
Rua Gastão Vieira, nº 471 - Parque Sta. Felicitá Jardim  
São Carlos - São Paulo - CEP: 13562-410  
TELEFONE: (16)3373-7790 - FAX: (16)3373-7799

## Prefácio

Obrigado por adquirir nosso dispositivo foto Polimerizador Modelo LED-6.

Por favor, leia este manual cuidadosamente, antes de utilizar o aparelho.

## Características

1. Alto brilho - Os componentes LED apresentam excelente rendimento luminoso.
2. Luz azul pura - Podem ser evitados efeitos colaterais da energia calorífica do IR.
3. Maior vida útil - Este tipo de LED pode ser utilizado por vários anos.
4. Silencioso - Como não se faz necessário a utilização de um ventilador resfriador, o aparelho trabalha de forma silenciosa, sem qualquer tipo de barulho.
5. Economia de energia - Este aparelho consome menos de 20VA de potencia, o consumo é 1/5 do conjunto de lâmpada halógena tradicional.
6. Medida da intensidade luminosa: Para medir a intensidade luminosa do aparelho, é necessário a utilização de um radiômetro digital utilizados por dentistas especializados.

## USO

Este aparelho pode ser utilizado para polimerizar o composto de resina que é solidificado pela luz visível. Permitindo o tratamento dentário dos pacientes. Pode também ser utilizado para clareamento, utilizando-se composto de clareamento apropriado (ativado por luz visível).  
O modo e o tempo inicial permanecem ajustados de acordo com a última utilização.

O aparelho é testado e aprovado pela EMC de acordo com a EN60601-1-2, mas pode provocar interferências com outros equipamentos sensíveis de forma acidental, neste caso é aconselhável seguir as sugestões abaixo:

- Conectar o aparelho e equipamentos sensíveis em tomadas diferentes
- Aumentar a distância entre o dispositivo e aparelhos sensíveis .

## Especificações Técnicas

### Especificações Gerais

- Tipo de segurança: Classe II, Tipo B
- Sem Proteção contra penetração de Água: IPX0
- Não indicado o uso na presença de anestésicos inflamáveis com ar, oxigênio ou óxido nítrico.
- Consumo de força: 20 VA
- Condições de Trabalho: Temperatura: 5 ~ 40oC Umidade Relativa: ≤ 80 %.
- Condições de Transporte e Armazenamento: Temperatura: -0~+45oC; Umidade Relativa :≤80 %

**Responsável Técnico:**

Michelangelo Fernando Dalsasso - CREA-SP: 5063781865

Registro ANVISA: 80022409009

## Termo de garantia:

Esta garantia é válida somente no Território Nacional.

A garantia cobre defeitos de fabricação ou de materiais pelo prazo de 12 meses decorridos, desde a data da compra comprovada pela Nota Fiscal (de compra) do produto pelo primeiro comprador e dentro dos termos relacionados neste manual.

A Kondentech garante ao usuário do produto os serviços de assistência técnica, troca de componentes ou partes, bem como mão-de-obra necessários para reparos de eventuais defeitos, comprovadamente originários de fábrica.

Este serviço de garantia será prestado somente pela Kondentech, ou por empresas por ela credenciadas.

Para efeito de prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentado juntamente com o produto, o Certificado de Garantia preenchido e a cópia da Nota Fiscal. O produto deverá ser devidamente embalado e enviado com as despesas de remessa pagas pelo proprietário do produto.

A Kondentech se exime da responsabilidade por danos pessoais ou materiais decorrentes da utilização inadequada deste produto, devendo o usuário tomar as providências necessárias a fim de evitar tais ocorrências. No caso de reparos fora da garantia, a mesma se estende somente aos componentes substituídos.

## A GARANTIA FICAAUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

- 1- O produto for utilizado fora das especificações técnicas citadas neste manual.
- 2- O produto sofrer modificação ou conversão elétrica, mecânica, estética, que mudem suas características originais.
- 3- O produto apresentar sinais internos ou externos de batidas ou maus tratos.
- 4- O produto for aberto para conserto, manuseado ou tiver o circuito original alterado por técnico não autorizado.
- 5- Não forem respeitadas as observações quanto à sua conservação, limpeza e utilização indicados nas Instruções de Uso.
- 6- O número de série do produto for removido ou alterado.

## ITENS NÃO COBERTOS PELA GARANTIA:

- 1- Danos causados por acidentes de transporte e manuseio. Exemplo: riscos, amassados, placas de circuito impresso quebradas, gabinete trincado, etc.
- 2- Danos causados por uso indevido, funcionamento em ambientes ou condições fora das especificações indicadas no manual, utilização de fonte de alimentação imprópria.

LOTE 7  
LICITANTE 3



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA
PROPOSTA
<b>Modalidade e Número do Pregão:</b> Pregão Eletrônico nº 023/2019SRP
<b>Objeto:</b> SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO IÉUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, conforme especificações do termo de referência, constante dos Anexos do Edital.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA ODONTOLÓGICO	KONDENTEK	UNIDADE	10	R\$ 2.540,00 (dois mil quinhentos e quarenta reais)	R\$ 25.400,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos reais)
02	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO.	AGIR	UNIDADE	10	R\$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais)	R\$ 4.430,00 (quatro mil quatrocentos e trinta reais)
03	MOCHO ODONTOLÓGICO GIRATÓRIO ESMALTADO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA POLUIRETANO INJETADA COM REVESTIMENTO EM COURVIM. BASE TUBULAR EM AÇO DE ALTA RESISTENCIA PINTADO COM TINTA EPOXI-PÓ E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTAS TEMPERATURAS, DIAMETRO DE 3/4" X 12 MM, APOIO TRIPLO, PÉS COM RODIZIOS DE DUPLO GIRO. REGULÁVEL EM ALTURA ATRAVÉS DE MOVIMENTO GIRATÓRIO DO ASSENTO, ALTURA MÍNIMA: 460 MM, ALTURA MÁXIMA: 700 MM. COM REGULAGEM A GÁS.	QUALITY	UNIDADE	2	R\$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais)	R\$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais)
04	BIOMBO PLUMBIFERO CURVO DE 1MM, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, COM VISOR DE VIDRO PLUMBIFERO TAMANHO 10X15CM, MONTADO SOBRE RODIZIOS, DIMENSÕES: LARGURA - 80 CM, ALTURA 180CM	KONEX	UNIDADE	1	R\$ 12.133,00 (doze mil cento e trinta e três reais)	R\$ 12.133,00 (doze mil cento e trinta e três reais)
05	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	SCHUSTER	UNIDADE	1	R\$ 5.716,00 (cinco mil setecentos e dezesseis reais)	R\$ 5.716,00 (cinco mil setecentos e dezesseis reais)
06	DESTILADOR PRA AGUA	CRISTOFOLI	UNIDADE	1	R\$ 1.843,00 (um mil oitocentos e quarenta e três reais)	R\$ 1.843,00 (um mil oitocentos e quarenta e três reais)

*[Handwritten signatures]*



07	FOTOPOLIMERIZADOR	KONDEN TEK	UNIDADE	1	R\$ 820,00 (oitocentos e vinte reais)	R\$ 820,00 (oitocentos e vinte reais)
----	-------------------	------------	---------	---	--	--

<b>Valor Total do lote: R\$ 51.296,00 (CINQUENTA E UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)</b>
<b>Prazo de Entrega: Conforme os termos do Edital.</b>
<b>Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.</b>
<b>Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.</b>
<b>Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).</b>
<b>Data: 05/12/2019</b>

LOTE 7  
LICITANTE 4



NOME DO ORGÃO/MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
Nº DO PREGÃO: 023/2019 SRP

ATRAVES DO PRESENTE DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSAO AOS DITAMES LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, SUBSIDIADA PELA LEI Nº 8.666/93 E SUA POSTEIORES ALTERAÇÕES E, ÀS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE PREGÃO.

DECLARAMOS QUE, NOS PREÇOS APRESENTADOS, BEM COMO NOS LANCES, ESTAO INCLUIDOS TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DE IMPOSTOS, TAXAS, ENTRE OUTROS.

DECLARAMOS AINDA QUE, CUMPRO PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE A CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

OBJETO:REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	VL UNIT	VL TOTAL
1	APARELHO DE ULTRASSONOGRÁFIA ODONTOLÓGICO	UND	10	KONDERTECH	R\$ 2.540,00	R\$ 25.400,00
2	SELADORA PARA PEPEL GRAU CIRÚRGICO	UND	10	2I	R\$ 443,67	R\$ 4.436,70
3	MOCHO ODONTOLÓGICO GIRATÓRIO ESMALTADO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA POLIURETANO INJETADA COM REVESTIMENTO EM COURVIM. BASE TUBULAR EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA PINTADO COM TINTA EPOXI-PÓ E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTAS TEMPERATURAS, DIAMETRO DE 3/4" X 12 MM, APOIO TRIPLO, PRÉS COM RODÍZIOS DE DUPLO GIRO. REGULÁVEL EM ALTURA ATRAVÉS DE MOVIMENTO GIRATÓRIO DO ASSENTO, ALTURA MÍNIMA: 460 MM, ALTURA MÁXIMA: 700 MM. COM REGULAGEM A GÁS.	UND	2	J.FLEX	R\$ 477,67	R\$ 955,34
4	BIDMO PLUMBIFERO CURVO DE 1MM, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, COM VIŠOR DE VIDRO PLUMBIFERO TAMANHO 10x15CM, MONTADO SOBRE RODÍZIOS, DIMENSÕES: LARGURA - 80 CM, ALTURA: 180 CM	UND	1	LGA	R\$ 12.133,33	R\$ 12.133,33
5	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	UND	1	BIOTRON	R\$ 5.716,67	R\$ 5.716,67
6	DESTILADOR PRA ÁGUA	UND	1	CRISTOFOL	R\$ 1.843,33	R\$ 1.843,33
7	FOTOPOLIMERIZADOR	UND	1	KONDERTECH	R\$ 820,00	R\$ 820,00
VL TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 51.305,37	

#NOME?

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.  
ITAITINGA/CE, 16 DE DEZEMBRO DE 2019.

1

LOTE 7  
LICITANTE 5



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2019 SRP

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE.

CARTA PROPOSTA

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QTDE	MARCA	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA ODONTOLÓGICO	UND.	10	D700 ALLIAGE	2.540,00	25.400,00
2	SELADORA PARA PÁPEL GRAU CIRÚRGICO	UND.	10	VH	443,67	4.436,70
3	MOCHO ODONTOLÓGICO GIRATORIO ESMALTADO COM ASSENTO E ENCASTO ESTOFADO EM ESPUMA POLIURETANO INJETADA COM REVESTIMENTO EM COURVIM. BASE TUBULAR EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA PINTADO COM TINTA EPOXI-PÓ E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTAS TEMPERATURAS, DIÂMETRO DE 3/4" X 12MM, APOIO TRÍPLIO, PÉS COM RODÍZIOS DE DUPLO GIRO, REGULÁVEL EM ALTURA ATRAVÉS DE MOVIMENTO GIRATORIO DO ASSENTO, ALTURA MÍNIMA: 460MM, ALTURA MÁXIMA: 700MM, COM REGULAGEM A GAS.	UND.	2	D700 ALLIAGE	498,13	996,26
4	SIOMBO PLUMBÍFERO CURVO DE 1MM, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, COM VISOR DE VIDRO PLUMBÍFERO TAMBÉM 10X15CM, MONTADO SOBRE RODÍZIOS, DIMENSÕES: LARGURA - 80 CM, ALTURA 1 180CM	UND.	1	KONEX	12.926,40	12.926,40
5	CONVERSOR ODONTOLÓGICO	UND.	1	D700 ALLIAGE	5.716,67	5.716,67
6	DESTILADOR PARA ÁGUA	UND.	1	D700 ALLIAGE	1.843,33	1.843,33
7	FOTOPOLIMERIZADOR	UND.	1	KONDENTECH	820,00	820,00
Valor Global da Carta Proposta R\$						52.139,36
CINQUENTA E DOIS MIL, CEM E TRINTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS						

Prazo de Entrega: 10 (dez) dias.

Prazo de Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) DIAS.

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

*[Handwritten signatures]*

1



LOTE 7  
LICITANTE 6



A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

PREGÃO ELETRONICO N° 023/2019-SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA ODONTOLÓGICO	UNID	10	ALT	R\$ 3.750,00	R\$ 37.500,00
2	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO	UNID	10	M SELP	R\$ 567,00	R\$ 5.670,00
3	MOCHO ODONTOLÓGICO GIRATÓRIO ESMALTADO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA POLIURETANO INJETADA COM REVESTIMENTO EM COURVIM. BASE TUBULAR EM AÇO DE ALTA RESISTENCIA PINTADO COM TINTA EPOXI-PÓ E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTAS TEMPERATURAS, DIAMETRO DE 3/4" X 12 MM, APOPIO TRIPLO, PÉS COM RODIZIOS DE DUPLO GIRO. REGULÁVEL EM ALTURA ATRAVÉS DE MOVIMENTO GIRATÓRIO DO ASSENTO, ALTURA MINIMA: 460 MM, ALTURA MÁXIMA: 700 MM. COM REGULAGEM A GÁS.	UNID	2	IFLEX	R\$ 807,00	R\$ 1.614,00
4	BIOMBO PLUMBIFERO CURVO DE 1MM, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, COM VISOR DE VIDRO PLUMBIFERO TAMANHO 10X15CM, MONTADO SOBRE RODIZIOS, DIMENSÕES: LARGURA - 80 CM, ALTURA : 180CM	UNID	1	N MARTINS	R\$ 8.694,39	R\$ 8.694,39
5	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	UNID	1	FIAC	R\$ 4.767,00	R\$ 4.767,00
6	DESILADOR PARA ÁGUA	UNID	1	CRISTOFOLI	R\$ 1.887,00	R\$ 1.887,00
7	FOTOPOLIMERIZADOR	UNID	1	SCHUSTER	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00
					R\$	61.272,39

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$	61.272,39
sessenta e um mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos		

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DOS BENS, REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A CONTRATAÇÃO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

FORTALEZA, 16 DE DEZEMBRO DE 2019.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

NOTE 9 - LICITANTE 7

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2019

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA DE LAVRAS DA MANGABEIRA



Item	Descritivo	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
01	APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA ODONTOLÓGICO MODELO: ULTRASSOM MAGNUS MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600008	UND	10	R\$ 2.540,00	R\$ 25.400,00
02	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO MODELO: SELABEM MARCA: BIOTRON FABRICANTE: BIOTRON PROCEDÊNCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	UND	10	R\$ 443,67	R\$ 4.436,70
03	MOCHO ODONTOLÓGICO GIRATÓRIO ESMALTADO REVESTIMENTO EM COURVIM. BASE TUBULAR EM AÇO DE ALTA RESISTENCIA PINTADO COM TINTA APOPIO TRIPLO, PÉS COM RODIZIOS DE DUPLO MOVIMENTO GIRATÓRIO DO ASSENTO, ALTURA MINIMA: 460 MM, ALTURA MÁXIMA: 700 MM. COM REGULAGEM A GAS. "Produto Fabricado Conforme ABNT NBR ISO 7493 e Resolução RDC 16 de 28/03/2013 (ANVISA), Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação de Produtos Médicos, Sistema de Gestão ISO 9.001/2008 e ISO 13.485/2004". MODELO: MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS MAGNUS PRATA ANATÔMICO COR DO ESTOFAMENTO: A COMBINAR MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	UND	02	R\$ 477,67	R\$ 955,34
04	BIOMBO PLUMBIFERO CURVO DE 1MM, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, COM VISOR DE VIDRO PLUMBIFERO TAMANHO 10X15CM, MONTADO SOBRE RODIZIOS, DIMENSÕES: LARGURA - 80 CM, ALTURA 180CM MODELO: 180X80 CM CURVO COM VISOR DE 01MM PB MARCA: BARBIERI FABRICANTE: J.C.BARBIERI E CIA LTDA PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	UND	01	R\$ 12.133,33	R\$ 12.133,33
05	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MODELO: PRIME AIR 40 MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED EQUIP. ODONT. PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	UND	01	R\$ 5.716,67	R\$ 5.716,67
06	DESTILADOR PRA AGUA MODELO: DESTILADORA 110V OU 220V MARCA: CRISTOFOLI	UND	01	R\$ 1.843,33	R\$ 1.843,33

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

	FABRICANTE: PROCEDENCIA RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARAGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)	CRISTOFOLI IMPORTADO					
07	FOTOPOLIMERIZADOR MODELO: LED MARCA: FABRICANTE: PROCEDÊNCIA REGISTRO DA ANVISA: 80022409009	KONDENTECH KONDENTECH NACIONAL	5	UND	01	R\$ 820,00	R\$ 810,00



VALOR TOTAL DO ITEM ..... R\$ 51.305,37  
(CINQUENTA E UM MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

Declaramos que esta proposta tem validade conforme Edital, no prazo de 60 (SESSENTA) DIAS, contados da data de abertura da mesma, e que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos Anexos.:

- Valor total da Proposta: R\$ 51.305,37 (CINQUENTA E UM MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)
- Prazo de Entrega: 10 (DEZ) DIAS - CONFORME EDITAL
- Prazo de validade da Proposta: 60 DIAS (SESSENTA DIAS ) - CONFORME EDITAL

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Belo Horizonte, 13 de Dezembro de 2019.

LOTE 7  
LICITANTE 8



Proposta Cliente : 19456

Página: 1

Cliente: PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Processo: PE 23 2019

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	254174	10	UN	REF. FÁBRICA: 1.01.05089 AP ULTRASSOM JATO SONIC PRIME ANALOGICO BIVOLT ECEL EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO ANALOGICO COM MODERNO SISTEMA DE PROFILAXIA GABINETE CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO RESISTENTE COMPOSTO POR CORPO BASE E TAMPA, PAINEL CONFECCIONADO EM POLICARBONATO AUTOADESIVO LOCALIZADO NA PARTE FRONTAL DO GABINETE QUE POSSUI AS FUNÇÕES E COMANDOS DO EQUIPAMENTO. PRESSURIZAÇÃO INTERNA DO AR E DA AGUA OCORRE NOS TERMINAIS DE ENTRADA E ATRAVÉS DAS VÁLVULAS SOLENOIDES O REGISTRO DE AGUA E AR PERMITE AJUSTE FINO. PEÇA DE MAO DO ULTRASSOM COM TRANSDUTOR MONTADO COM PASTILHAS CERÂMICAS PIEZOELETRICA FORNECE OSCILAÇÕES COM FREQUÊNCIAS ENTRE 29KHZ A 32KHZ O CONTROLE DA POTENCIA E AJUSTÁVEL. A PEÇA DE MAO DO JATO DE BICARBONATO COM DIFUSOR CONCÊNTRICO QUE EFETUA A MISTURA DO AR AGUA E BICARBONATO A UM PEQUENA DISTANCIA DA PONTA. RESERVATÓRIO PARA BICARBONATO COM O RECIPIENTE REMOVÍVEL E FILTRO DE AR PARA DRENAGEM SEMI-AUTOMATICA. PEDAL DE COMANDO PARA ACIONAMENTO E AS CAPAS DA PEÇA DE MAO DO ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO REMOVÍVEL E AUTOCLAVAVEL. PRESSÃO ENTRADA DE AGUA 138 KPA A 276 KPA, PRESSÃO ENTRADA DE AR 483 KPA A 552 KPA BIVOLT 127V / 220V SELECIONAVEL DIMENSÕES COMP X LARG X ALT 245X205X155MM PESO LIQUIDO 3,55KG PESO BRUTO 4,35KG GARANTIA 12 MESES INCLUSO 3 INSERTOS 1 CHAVE PARA INSERTO 1 FUSIVEL 1A M - SONIC PRIME F -- ECEL P -- NAC RMS 80366400010	2.254,67	22.546,70
				VLR UNITARIO: DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS VLR TOTAL: VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS		
02	248271	10	UN	REF. FÁBRICA: P079 SELADORA 30CM SELABEM BIVOLT BIOTRON SELADORA DESIGN MODERNO E INOVADOR COM ALCA DE APOIO PARA SELAGEM COM PROTECAO TERMICA QUE EVITA ACIDENTES. APOS AQUECIDA, SELAMENTO INSTANTANEO EM 3 SEGUNDOS. CHASSI METALICO DE ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPOXI ELETROSTATICA CONFERINDO SEGURANCA A QUALIDADE E DURABILIDADE AO PRODUTO. AREA DE SELAGEM EM ACO INOXIDAVEL. AQUECIMENTO UNIFORME EM TODA A AREA DE SELAGEM. ACIONAMENTO ATRAVES DE CHAVE LIGA/DESLIGA COM ILUMINACAO. NAO NECESSITA MANUTENCOES. ESPECIFICACOES TECNICAS: ALIMENTACAO BIVOLT TEMPO DE PRE AQUECIMENTO MEDIA DE 7 MINUTOS TEMPO DE SELAGEM DEPOIS DE AQUECIDA 3 SEGUNDOS DIMENSOES DO PRODUTO 36X11X6 5 CM . POTENCIA 50W AREA DE SELAGEM 30CMX14MM AREA SELADA 25CMX10MM. GARANTIA DE 1 ANO. *****FAVOR INFORMAR VOLTAGEM NO EMPENHO***** M- SELABEM F- BIOTRON P-NAC RDC-185	259,02	2.590,20
				VLR UNITARIO: DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS VLR TOTAL: DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE CENTAVOS		
03	254992	2	UN	REF. FÁBRICA: MOCHO A GAS BACK SYSTEM GG EQUIPAMENTOS MOCHO A GAS COM ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS E ESTOFADOS REVESTIDO EM CURVIM SISTEMA DE ELEVACAO DO ASSENTO, ALTURA REGULAVEL COM	755,28	1.510,56

1

Proposta Cliente : 19456



Cliente: PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.		VLR. UNITARIO	TOTAL
				ALAVANCA LATERAL ENCOSTO COM REGULAGEM SISTEMA BACK SYSTEM ALTURA MINIMA 420MM ALTURA MAXIMA 540MM BASE GIRATORIA COM 05 RODIZIOS DUPLOS EM NYLON INJETADO PISTAO EM ACO INOX ESTRUTURA DOS PES METALICA REVESTIMENTO EM PVC M – BACK SYSTEM F – GG EQUIPAMENTOS P – NAC RDC 260		
				VLR UNITARIO: SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS VLR TOTAL: UM MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS		
04	254781	1	UN	REF. FÁBRICA: IMM CV MAD CD BIOMBO 1MMPB CURVO 180X80CM C VISOR MAD CV HDX BIOMBO PLUMBIFERO CURVO COM VISOR ACABAMENTO MDF CONSTRUIDO COM ESTRUTURA EM ACO E REVESTIDO COM PINTURA EM EPOXI ELETROSTATICA. INSTALADO SOBRE 4 RODIZIOS GIRATORIOS DE ALTA RESISTENCIA E ACABAMENTO EM INOX ESPESSURA: 1MM CHUMBO PINTURA: EPOXI ELETROSTATICA DIMENSAO: 180 X 80CM COM VISOR 10X15CM M – HDX F – HDX P – NAC	5.258,85	5.258,85
				VLR UNITARIO: CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS VLR TOTAL: CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS		
05	15302	1	UN	REF. FÁBRICA: 8975706092 COMPRESSOR ISENTO CD TOP 7 30L BIVOLT FIAC COMPRESSOR ISENTO DE OLEO, RESERVATORIO 30LT, VOLUME DE AR A SPIRADO 7,06PCM 200LTS/MIN, PRESSAO MAX. DE OPERACAO 120LBF/ POL, 1 CABECOTE, 1 ESTAGIO, NIVELDE RUÍDO 75DBA, PINTURA INT ERNA,REGULADOR DE PRESSAO,ACIONAMENTO DO MOTOR DIRETO DIMENSOES: 60X31X70CM PESO 28,5KG,COM VALVULA SEGURANCA GARANTIA 01 ANO POTENCIA 1,5CV, ROTACAO 1700RPM, PRTOTEOR ELETRICO, BIVOLT. M-CD TOP 7/30 F-FIAC P-NAC RMS:RDC 185	3.029,78	3.029,78
				VLR UNITARIO: TRÊS MIL, VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS VLR TOTAL: TRÊS MIL, VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS		
06	255582	1	UN	REF. FÁBRICA: DESTILADOR DE AGUA 127V BIOTRON DESTILADOR DE AGUA PURIFICA A AGUA, ELIMINANDO 99,9% DAS IMPUREZAS PRATICIDADE DE OBTEN SOMENTE A QUANTIDADE DE AGUA NECESSARIA PARA DETERMINADOS PROCEDIMENTOS; LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO; PARTES INTERNAS DE ACO INOXIDAVEL GARANTINDO MELHOR RESISTENCIA E DURABILIDADE; SENSOR PARA DESLIGAMENTO AUTOMATICO QUANDO ACABAR A AGUA CAMARA; PORTATIL, DESIGN MODERNO E INOVADOR; CONFECCIONADO EM MATERIAL DE FACIL LIMPEZA; FILTRO DE CARVAO ATIVADO, PARA ELIMINAR OS TRACOS DE SABOR E ODOR; GARRAFA PLASTICA PARA COLETA DE AGUA. ALIMENTACAO: 220V OU 127V FREQUENCIA: 50/60 HZ POTENCIA: 750W PRODUCAO: 1000 ML/HORA CAPACIDADE MAXIMA: 4 LITROS TEMPERATURA: 160°C DIMENSOES DO PRODUTO: 230 X 230 X 390 MM (C X L X A) DIMENSOES DO PRODUTO EMBALADO: 285 X 260 X 470 MM (C X L X A) PESO DO PRODUTO EMBALADO: 4,400 KG GARANTIA: 1 ANO M – BIOTRON F – BIOTRON P – NAC RDC 260	844,72	844,72
				VLR UNITARIO: OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS VLR TOTAL: OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS		
07	251536	1	UN	REF. FÁBRICA: AP FOTOPOLIMERIZADOR NEW BLUESTAR SEM FIO MICRODONT APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR NEW BLUESTAR S/ FIO 1500MW/MM2 DE POTENCIA, 3 MODOS DE OPERACAO (CONTINUO, PULSADO 1X1 SEG E RAMP) E PONTEIRA DE FIBRA ÓTICA 100% COERENTE E AUTOCLAVÁVEL FONTE DE ALIMENTAÇÃO FULLRANGE (110/220VAC @ 50A60HZ) BATERIA CAPACIDADE DE	573,12	573,12

*[Handwritten signatures and initials]*

Proposta Cliente : 19456



Cliente: PREFEITURA MUNIC DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ITEM	COD. PROD.	QTDE	UN.	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
				2200MAH VOLTAGEM 3.7V PODE SER RECARREGADA SEM QUE ESTEJA TOTALMENTE DESCARREGADO SEM VICIO, PROTETOR DE RADIACAO LUMINOSA EM ACRILICO POLARIZADO CORPO E BASE CARREGADORA FABRICADO EM POLICARBONATO INJETADOS EM ABS, COM OPCAO DE DESCANSO DO APLICADOR CONTROLE DO TEMPO DE APLICACAO PROGRAMAVEL DE 5 A 40S DE 5 EM 5 SEGUNDOS INDIVIDUALMENTE POR MODO COMPRIMENTO DA ONDA DE 450NM A 500NM SISTEMA STAND BY DESLIGAMENTO AUTOMATICO SEM USO APOS 3 MINUTOS M - NEW BLUESTAR F - 3R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI P - NAC RMS 80676929003	

VLR UNITARIO: QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS  
VLR TOTAL: QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS

TOTAL DA PROPOSTA: 36.353,93  
TRINTA E SEIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS  
VALOR TOTAL COM DESCONTO: 36.353,93  
PREGAO ELETRONICO 23 2019  
MENOR PRECO POR ITEM  
CONTRATO 12 MESES  
VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS  
ENTREGA 10 DIAS  
PAGAMENTO 30 DIAS

*[Handwritten signatures]*

LOCAL, 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

LOTE 7  
LICITANTE 11



À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGABEIRA  
Secretaria de Saúde  
Comissão Permanente de Licitação

OBJETO: AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE.

**REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023.2019**

**ABERTURA: 16 / 12 / 2019 ÀS 08: 15 H**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
1	APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA ECEL ODONTOLÓGICO		10	UND	3.302,00	33.020,00
2	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO	SISPACK	10	UND	576,77	5.767,70
3	MOCHO ODONTOLÓGICO GIRATÓRIO J. FLEX ESMALTADO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO EM ESPUMA POLUIRETANO INJETADA COM REVESTIMENTO EM COURVIM. BASE TUBULAR EM AÇO DE ALTA RESISTENCIA PINTADO COM TINTA EPOXI-PÓ E SECAGEM EM ESTUFA DE ALTAS TEMPERATURAS, DIAMETRO DE 3/4" X 12 MM, APOIO TRIPLO, PÉS COM RODIZIOS DE DUPLO GIRO. REGULÁVEL EM ALTURA ATRAVÉS DE MOVIMENTO GIRATÓRIO DO ASSENTO, ALTURA MINIMA: 460 MM, ALTURA MÁXIMA: 700 MM. COM REGULAGEM A GAS.		2	UND	620,97	1.241,94
4	BIOMBO PLUMBIFERO CURVO DE 1MM, ODONTOLO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E GIC PINTADO, COM VISOR DE VIDRO PLUMBIFERO TAMANHO 10X15CM, MONTADO SOBRE RODIZIOS, DIMENSÕES: LARGURA - 80 CM, ALTURA :180CM		1	UND	15.773,33	15.773,33
5	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	MOTOMIL	1	UND	7.431,67	7.431,67
6	DESTILADOR PRA AGUA	QUIMIS	1	UND	2.396,33	2.396,33
7	FOTOPOLIMERIZADOR	ECEL	1	UND	1.066,00	1.066,00

66.696,97

sessenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$	66.696,97
sessenta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos	

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão publica do**



**PRAZO DE ENTREGA:** 10 (dez) dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA pela administração, no local determinado na ORDEM DE COMPRA.

**PRAZO DE GARANTIA/VALIDADE DOS MATERIAIS:** 12 (DOZE) MESES, Conforme edital

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Declaramos que, nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais e demais ônus diretos e indiretos que incidam sobre a execução do objeto desta licitação.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas neste edital. (artigo 21, § 2º, do Decreto nº 5450/2005).

Declaramos ainda que respondemos por todos os prejuízos, perdas e danos que venham a ocorrer referentes ao transporte e fornecimento dos produtos, caso venha a ser contratado.

Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.



LOTE 7  
LICITANTE 10

PROPOSTA DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal do LAVRAS DA MANGABEIRA - CE  
Att. Senhor(a) Pregoeiro(a)  
Referente Pregão Eletrônico nº 023/2019 - SRP



Data e Horário de Abertura: 16 de Dezembro de 2019 às 08hs15min  
Data e Horário dos Lances: 16 de Dezembro de 2019 às 10hs00min  
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

Condições Gerais da Proposta:

- \* Prazo de Validade da Proposta: 60(sessenta) Dias
- \* Os Produtos terão garantia mínima de 12 (doze) meses.
- \* Prazo de Entrega : Conforme edital.
- \* Prazo para Pagamento: Conforme Edital

Informamos interia submissão às cláusulas e condições existentes no Edital e seus anexos como também aos dilames das Leis e Decretos que regem este

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. UNIT. P. EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL P. EXTENSO
1	APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA ODONTOLÓGICO com jato de bicarbonato. - Sistema piezoelétrico; Peça de mão autoclavável e removível; Bivolt; Filtro de ar com drenagem automática; Controle independente de fluxos de água e pó.	Unid.	10	Scaler Jet	R\$ 2.595,04	dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quatro centavos	R\$ 25.950,44	vinte e cinco mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos
2	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO. - De mesa com guilhotina; Material em aço carbono; Sistema para aquecimento com resistência blindada; Área de selagem de 35cm; Bivolt.	Unid.	10	Sela Tech	R\$ 1.599,88	um mil, quinhentos e noventa e oito reais e oito centavos	R\$ 15.998,80	quinze mil, novecentos e noventa e oito reais e oito centavos
3	MOCHO ODONTOLÓGICO GIRATÓRIO ESMALTADO - Assento e encosto em espuma poliuretano injetada com revestimento em courviã. Base tubular em aço de alta resistência pintando com tinta epoxi-pó e secagem em estufa de altas temperaturas, diametro de 3/4 x 12 MM, apoio triplo, pés com rodízios de duplo giro. Regulável em altura mínima; 460 mm, altura máxima; 700mm. Com regulagem a gás.	Unid.	2	Tubomed	R\$ 693,58	seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 1.387,17	um mil, trezentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos
4	BIOMBO PLUMBIFERO CURVO DE 1MM - Construido em chapa de aço tratado e pintado, com visor de vidro plumbifero tamanho 10x15cm, montando sobre rodízios, dimensões; Lavra 80cm, altura 180cm	Unid.	1	Tubomed	R\$ 538,76	quinhentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos	R\$ 538,76	quinhentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos
5	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, totalmente isento de Óleo, com capacidade mínima de atendimento a 1 consultório, pressostato automático liga/desliga, reservatório mínimo de 40 litros, 220V, potência mínima de 2HP, tanque com pintura eletrostática interna e externa, protetor térmico no motor elétrico, regulador de pressão com manômetro, filtro de ar, possui, garantia mínima de 12meses.	Unid.	1	Dabi	R\$ 7.101,25	sete mil, cento e um reais e vinte e cinco centavos	R\$ 7.101,25	sete mil, cento e um reais e vinte e cinco centavos
6	DESTILADOR PRA AGUA, minimo de 3,5 litros por hora, com desligamento , automatico, 220v, garantia minima de 1 ano.	Unid.	1	Aqua Tech	R\$ 1.414,18	um mil, quatrocentos e quatorze reais e dezoito centavos	R\$ 1.414,18	um mil, quatrocentos e quatorze reais e dezoito centavos
7	FOTOPOLIMERIZADOR de led com fio, modo de operação: rápida gradual e pulsante. Garantia mínima de 12 meses.	Unid.	1	Kondentech	R\$ 719,95	setecentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos	R\$ 719,95	setecentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos
<b>Valor Global da Proposta</b>							<b>R\$ 53.110,55</b>	
cinquenta e três mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos								

<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA:</b>	<b>R\$</b>	<b>53.110,55</b>
cinquenta e três mil, cento e dez reais e cinquenta e cinco centavos		

Fortaleza-Ce., 16 de Dezembro de 2019

Atenciosamente;

*[Handwritten signatures]*



**A Pregoeira do Município de LAVRAS DA MANGABEIRA - CE**  
**Referente PREGÃO ELETRONICO Nº 023/2019 - SRP**  
**DATA E HORA DA ABERTURA: 16/12/2019 às 08h15hs**  
**DATA E HORA DA DISPUTA: 16/12/2019 às 10h00min**

### DECLARAÇÕES

Declara condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual descumprimento das condições de participação, através dos seguintes procedimentos:

Declara que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório;

Verificação da existência de sanção que impeça a participação neste Pregão Eletrônico, ou a futura contratação, mediante a consulta dos cadastros em epigrafe no edital.

(1) que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos do Edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório; e (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital;

Que atenderemos as exigências do edital no que se refere à habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que está regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, FGTS E CNDT;

Que temos pleno conhecimento e concordamos com todos os termos e exigências constantes nas cláusulas do referido edital;

Que nos submetemos e estamos de pleno acordo com todos os termos e condições previstas no instrumento convocatório;

Que em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/199, publicada do DOU de 28/10/199, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não possui em seu quadro de pessoal empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e que inexistem quaisquer fatos supervenientes impeditivos de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93;

Que temos pleno conhecimento, aceitação e cumprimos todas as obrigações, parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que nossa proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital;

Que nos valores ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento dos bens, referente a tributos, encargos sociais trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a construção, inclusive a margem do lucro e demais ônus à execução do objeto desta licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente entregar os produtos, objeto desta licitação, caso sejamos vencedores, incluindo quanto à forma e prazo de fornecimento dos produtos.

Validade da Proposta: 60(sessenta) dias, – Prazo de Entrega: de acordo com o edital, ou seja, entregar os produtos no prazo máximo de 30(trinta) dias após o recebimento da Ordem de Compra – Forma de Pagamento: de acordo com o edital.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma o presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza (CE), 16 de Dezembro de 2019.

Atenciosamente;

LOTE 7  
LICITANTE 9

A

**GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**  
SETOR DE LICITAÇÃO

(88) 3536-1600  
PREG:JOAB

REF - PREGÃO ELETRÔNICO 0232019

BBMNET

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UND	MARCA	P UNIT	P TOTAL
1	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA ODONTOLÓGICO	10	UNID	ALT-ALTRONIC JET CERAMIC	R\$ 2.540,00	R\$ 25.400,00
2	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO	10	UNID	AGIR-PROTECT SEAL BASIC 31 cm	R\$ 443,67	R\$ 4.436,70
3	MOCHO ODONTOLÓGICO	2	UNID	KAVO-FISIOMOCHO	R\$ 477,67	R\$ 955,34
5	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO	1	UNID	FIAC-CDTOP730	R\$ 5.716,67	R\$ 5.716,67
6	DESTILADOR PRA AGUA	1	UNID	KONDENTECH-AQUATEC	R\$ 1.843,33	R\$ 1.843,33
7	FOTOPOLIMERIZADOR	1	UNID	ECEL-EC450	R\$ 820,00	R\$ 820,00
	TOTAL DA PROPOSTA		UNID		R\$	R\$ 39.172,04

PRAZO DE ENTREGA - CONFORME EDITAL.  
PRAZO DE PAGAMENTO - CONFORME EDITAL.  
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA - CONFORME EDITAL.  
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO - CONFORME EDITAL.  
PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS - CONFORME EDITAL.  
DECLARAMOS ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E LEIS QUE REGEM O PRESENTE EDITAL.  
DECLARAMOS QUE NOSSA EMPRESA ESTÁ ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

ARAPONGAS PR 07 DE DEZEMBRO DE 2018



*[Handwritten signatures]*